
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE MIXTO QUE TIENE POR OBJETO LA CONTRATACIÓN DE:

“SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, INCLUIDO MANTENIMIENTO POR REPOSICIÓN, PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA E INSTRUMENTAL DE LA MARCA KARL STORZ DE DIFERENTES SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA DE SALUD I MURCIA-OESTE”

1. OBJETO DEL CONTRATO

Será objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas en adelante PPT, regular por parte del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en adelante HCUVA, el Servicio de Mantenimiento Integral incluido el mantenimiento por reposición de los Equipos de Endoscopia e Instrumental de la marca Karl Storz, adjuntos en Anexo II, existentes en diferentes Servicios del HCUVA, con el fin de mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos objeto del contrato.

Este PPT tendrá como objeto regular y definir el alcance y condiciones de prestación de los servicios a contratar, procesos, metodología, normativa a aplicar y recursos humanos y técnicos a emplear.

2. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

El servicio a contratar tiene por finalidad la de mantener en todo momento los Equipos de Endoscopia y el Instrumental, en perfecto estado de funcionamiento, mediante la ejecución de los distintos tipos de mantenimiento, entendiéndose en todo caso que los requisitos exigidos en este PPT tienen la consideración de mínimos o básicos, y que lo pretendido es la consecución de los objetivos de calidad determinados por el HCUVA y que se indican a continuación.

- Mejorar el estado de conservación de los equipos y sus componentes.
- Asegurar el funcionamiento continuo y eficaz de los equipos y sus componentes, minimizando las posibles paradas como consecuencia de averías y alcanzar el máximo índice de disponibilidad.
- Garantizar el tiempo de respuesta, aplicando todas las medidas tecnológicas disponibles.
- La seguridad integral referida a los aspectos técnicos de estos equipos.
- El cumplimiento de la normativa vigente referente a los equipos objeto del contrato.
- La prestación de un eficiente y eficaz servicio de mantenimiento.
- Llevar un registro informatizado de todos los mantenimientos realizados sobre los equipos, así como datos de costes, disponibilidad y aquellos que requiera el Responsable del seguimiento del contrato.
- Formar al usuario en el manejo y máximas prestaciones de los equipos.
- Gestión informatizada del Servicio.

3. PRESTACIONES

La Empresa Adjudicataria realizará las prestaciones sobre los equipos e instrumentos que se relacionan en Anexo II adjunto a este PPT, considerándose dicho anexo orientativo y no exhaustivo.

Las prestaciones a realizar serán las correspondientes a un Mantenimiento Integral y el mantenimiento por reposición equipos, que aseguren la operatividad de los equipos, incluidos equipos electrónicos, en el periodo de vigencia del contrato, y que abarquen los puntos que se indican a continuación:

3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se realizará un Mantenimiento Preventivo de acuerdo a los protocolos de fábrica que tenga establecido el equipo, previa fijación de un calendario que será aprobado por el Servicio afectado y el Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento.

Este mantenimiento se realizará sobre los equipos incluidos en Anexo I, y cumplirán con unas condiciones mínimas, en cuanto a número de revisiones anuales, estando incluidas inspecciones mecánicas, eléctricas y biológicas. En estas inspecciones se incluirán todas las actividades de revisión y comprobación de las prestaciones del equipo, inspección, regulación, calibración, ajuste y pequeñas correcciones que sean necesarias, para lograr que los equipos estén dentro de sus especificaciones técnicas y las mismas se mantengan garantizando la prestación del servicio.

Las revisiones preventivas serán como mínimo una anual.

La Empresa Licitadora presentará en su Oferta Técnica el Plan de Mantenimiento Preventivo que llevará a cabo sobre los equipos objeto de contrato, adjuntando:

- Cronograma o Planing, indicando frecuencia de los mantenimientos previstos durante la duración del contrato.
- Plantilla con todas las acciones que se van a desarrollar sobre los equipos en los mantenimientos que tiendan a asegurar un estado óptimo de los equipos desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendimiento energético e incluso de protección a las personas, a la salud y al medio ambiente.

El Mantenimiento Preventivo incluye el ajuste y sustitución de todas las piezas que por recomendaciones del fabricante o por encontrarse averiado sea necesario su cambio. En caso de no poder reparar algún elemento se procederá a su sustitución. En cualquier caso el precio de piezas o materiales que haya que sustituir está incluido en el precio total del contrato.

La Empresa Adjudicataria entregará el "Manual de Mantenimiento Preventivo" de los equipos objeto del contrato y en el que se definan todas las actuaciones a realizar desde el punto de vista de tareas y de documentación para llevarlo a cabo, según condiciones establecidas en el PPT.

A la firma del contrato deberá realizarse la primera revisión de Mantenimiento Preventivo. En el caso de que coincida con la reparación de alguna avería existente o que surja en el transcurso de la revisión, al finalizar la misma los equipos deberán quedar en perfectas condiciones de funcionamiento.

Cualquier cambio que se produzca sobre el calendario del plan de Mantenimiento Preventivo será comunicado por escrito al HCUVA con al menos 15 días de antelación.

3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El Mantenimiento Correctivo será realizado sobre la totalidad de los equipos y accesorios, objeto del contrato realizándose sobre los mismos todo tipo de actuaciones tendentes a su reparación y puesta en servicio en los plazos más exiguos posibles.

Si las reparaciones implicaran parada de equipos o instalaciones, o riesgo de parada sobre otras instalaciones subsidiarias en marcha, se requerirá la autorización previa de la Dirección del centro o persona en quien delegue y serán realizadas en los horarios más idóneos para no entorpecer el normal desarrollo de la actividad asistencial.

Todas las actuaciones de Mantenimiento Correctivo deberán quedar registradas y ejecutarse respetando los procedimientos establecidos, con el conocimiento y autorización previa del Servicio afectado y del Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento del Hospital.

Cuando por las características de la avería no pueda efectuarse la reparación en el lugar donde esté situado el equipo, se dará cuenta al Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento, quien autorizará su retirada, siendo por cuenta del contratista todos los gastos inherentes a la misma, tales como: embalajes, seguros, transportes, retirada del equipo, entrega e instalación posterior, etc. Los equipos una vez reparados y en perfectas condiciones de uso para el fin que están destinados, se instalarán en su lugar habitual de ubicación.

El HCUVA no reconocerá ningún trabajo realizado fuera de contrato que no cuente con la autorización previa del Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento, aun cuando haya sido peticionado por cualquier persona de las que dependen laboral o estatutariamente del Hospital, no haciéndose cargo de los gastos que se hubieran producido.

En caso de los equipos videofibroskopios, fibroskopios flexibles y videolaparoskopios que no puedan ser reparados, se adjuntará informe técnico justificando la imposibilidad de reparación del mismo, realizándose la reparación por reposición. (Ver apartado 3.3)

En el caso de ópticas rígidas, instrumental quirúrgico, vainas y accesorios asociados a los sistemas ópticos, cables de luz, lámparas de las fuentes de luz y cables HF, todas las reparaciones se efectuarán por reposición, reemplazándolos por otros nuevos de la misma marca y modelo. (Ver apartado 3.3)

En cualquier caso todos los equipos averiados deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento, ya sea mediante reparación de los mismos, mediante su sustitución o su reposición, según las condiciones adjuntas a este pliego.

La Empresa Licitadora definirá en su Oferta Técnica el contenido y mecánica de actuaciones en este campo, o sistema operativo a desarrollar, tanto desde el punto de vista de tareas como de documentación y medios necesarios para llevarlas a cabo.

La realización del mantenimiento correctivo se realizará acorde al procedimiento de calidad del HCUVA cuyos puntos principales se enumeran a continuación:

- Cuando se detecte una avería el Servicio afectado será quien comunique y registre mediante Websap al Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento del HCUVA, dicha avería. El Servicio de Ingeniería Obras y Mantenimiento dará aviso a la empresa de mantenimiento mediante teléfono, correo electrónico o mediante otro medio con el que quede constancia escrita del mismo.

La empresa adjudicataria comunicará, en la medida de lo posible, en el mismo instante de la llamada, el día y la hora en la cual se realizará el mantenimiento correctivo en el equipo. Si no es posible proporcionar dicha información en el momento de la llamada, se comunicará posteriormente y lo antes posible tanto al Servicio afectado como al Servicio de Obras y Mantenimiento del HCUVA, ya sea telefónicamente o a través de correo electrónico.

- Cumplimiento de los tiempos máximos de respuesta (TMR).
- Una vez realizada la acción correctiva, la empresa adjudicataria hará llegar el Parte de Trabajo a las personas responsables del Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento del HCUVA.

3.3 MANTENIMIENTO POR REPOSICIÓN

Quedan incluidos en el presente contrato con carácter anual, la sustitución por reposición sin coste alguno para el HCUVA de los siguientes equipos:

- **30 ópticas rígidas**
- **4 fibroscopios flexibles**
- **4 videofibroscopios**
- **1 videolaparoscopio 3D**

En Anexo II a este pliego se adjuntan las características de los equipos anteriores.

Igualmente, quedarán incluidos en las sustituciones por reposición, sin límite:

- **Instrumental específico de la marca Karl Storz.**
- **Vainas y accesorios asociados a los sistemas ópticos de la marca Karl Storz.**
- **Cables de luz fría de Karl Storz.**
- **Lámparas de las fuentes de luz objeto del contrato.**
- **Cables de alta frecuencia (HF), monopolares y bipolares.**

Todos los equipos y componentes sustituidos deberán ser siempre nuevos y estarán actualizados por las nuevas versiones que vayan implementándose sin coste adicional. En cualquier caso estarán sometidos a las cláusulas del presente contrato. No se admitirán equipos reacondicionados.

Si anualmente no se sustituyesen el número de equipos indicados anteriormente, éstos se añadirán al siguiente año de vigencia del contrato, en el supuesto de prórroga del contrato. En caso que no se sustituyan todos los equipos a final de contrato, quince días antes de la finalización

del mismo, o en su caso de la prórroga, se llevará a cabo una regularización. El HCUVA junto con la empresa adjudicataria identificarán el equipamiento, siempre que esté relacionado con el objeto del contrato, que en ese momento sea preciso actualizar por obsolescencia o necesidad de algún servicio. Dicha renovación tecnológica estará debidamente justificada y será a cargo del importe pendiente que quede del actual contrato, estando la empresa adjudicataria obligada a suministrarlo.

La Empresa Licitadora deberá indicar en su Oferta Técnica precio de sustitución por reposición de todos los equipos que se adjunten en modelo de oferta, adjunto a este PPT, en anexo III.

En caso que fuese necesario durante la vigencia del contrato, la sustitución de equipos adicionales respecto a los indicados anteriormente que están incluidos en contrato, la Empresa Adjudicataria deberá mantener los precios por reposición de estos elementos que pudiera precisar el HCUVA.

En cualquier caso, todos los equipos que sean sustituidos, deberán tener su garantía correspondiente.

La empresa adjudicataria, en caso de reposición de equipo, vendrá obligada a la retirada del mismo, que se efectuará en condición de residuo de aparato eléctrico y electrónico (RAEE), conforme a las exigencias de la normativa específica aplicable (RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

La retirada del equipo y la gestión posterior del mismo como RAEE se efectuará mediante alguna de las opciones que se contemplan en el apartado 3º del modelo que se aporta en el Anexo IV del presente PPT ("ACUERDO DE CESIÓN / ENTREGA DE EQUIPOS CLASIFICADOS COMO APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (EN ADELANTE AEE) y RESIDUOS DE LOS MISMOS").

Antes de la retirada del equipo el adjudicatario deberá haber aportado el modelo del Anexo IV debidamente cumplimentado, así como la documentación complementaria a adjuntar, en cada caso, según opción de gestión del residuo seleccionada por el mismo conforme al apartado 3º del modelo. La retirada no podrá efectuarse sin la previa validación y firma por ambas partes.

3.4 ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS

En caso que sea necesaria la sustitución de las ópticas que no estén incluidas en el listado del Anexo II adjunto a este PPT, la Empresa Adjudicataria deberá suministrar otra óptica de iguales o superiores características (y en todo caso compatible con los equipos existentes) mediante reposición y ofreciendo un descuento del 20 % sobre el precio de mercado.

3.5 PRÉSTAMO DE EQUIPOS

En aquellos casos que el equipamiento dañado no pueda ser reparado o sustituido dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la avería, la Empresa Adjudicataria deberá proporcionar al HCUVA un equipo en préstamo sin coste para el Hospital, hasta que el equipo sea reparado o reemplazado por uno nuevo. El equipo en préstamo deberá ser de iguales o superiores características al equipo sustituido.

Todos los gastos asociados al préstamo de equipos correrán a cargo de la empresa adjudicataria.

4. EXCLUSIONES

Los servicios prestados en el presente contrato no incluyen;

- Daños o problemas que resulten de catástrofes naturales, como inundaciones, incendios, movimientos sísmicos,...,etc.
- Daños producidos por tecnología láser.
- Daños o averías que resulten de manifiesta negligencia, debiéndose adjuntar informe justificativo de la misma.

5. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La Empresa Adjudicataria revisará, actualizará y mantendrá el inventario de Equipos de Endoscopia e Instrumental objeto del contrato, comprobando ubicación y estado de todos los equipos y accesorios, todo ello en coordinación con el responsable de la Unidad de Inventario y Gestión Patrimonial del HCUVA. Igualmente mantendrá un inventario de los equipos dados de baja durante la vigencia de este contrato.

Toda la información quedará reflejada en soporte digital, en formato tipo excel y reflejará todos los datos que le sean exigidos por el responsable del contrato y con el formato que se le solicite.

La Empresa Adjudicataria entregará en un plazo no superior a tres meses, desde la fecha de formalización del contrato, un "Manual de Equipo", que recoja toda la documentación técnica organizada del equipo a mantener, adjuntando Libros de Mantenimiento, principios de funcionamiento, instrucciones de uso y conservación, y cualquier otra documentación de interés del equipo, todo ello en castellano. El HCUVA facilitará toda la documentación técnica de la que dispone en la actualidad, si bien, la Empresa Adjudicataria deberá completarla o desarrollar en su totalidad en caso que no exista. Toda la documentación obtenida quedará en propiedad del HCUVA y estará a disposición en soporte informático.

La Empresa Adjudicataria deberá establecer en un plazo no superior a tres meses, desde la fecha de formalización del contrato, un informe detallado desde el punto de vista técnico como legal, del estado de los equipos objeto del contrato y condiciones de uso y manejo habitual por parte del Servicio correspondiente, señalando las deficiencias observadas, con el fin de evaluar los posibles riesgos que puedan provenir de una mala praxis, posible fallo del equipo o deficiente mantenimiento, adjuntando la solución correspondiente en cada caso. Dicho informe se remitirá al Servicio de Obras y Mantenimiento del HCUVA.

Cada vez que se produzca una intervención sobre cualquier equipo objeto de este contrato, deberá quedar registrada en los Libros o Registros digitales de Mantenimiento, por la Empresa Adjudicataria.

Todas las intervenciones que se produzcan deberán registradas en un parte de trabajo, que deberá enviarse como máximo a las 24 horas al Servicio de Ingeniería, Obras y Mantenimiento. Se incluirá como mínimo la siguiente información:

- Equipo objeto intervención; ubicación, denominación, modelo, número serie....
- Fecha y hora del aviso.
- Diagnóstico de avería y causa.
- Acciones llevadas a cabo, preventivas /correctivas, y confirmación que el equipo queda en condiciones correctas de funcionamiento.
- Cualquier observación o recomendación que estimen oportuna.
- Fecha y hora fin de la intervención.
- Datos y firmas, del técnico que realiza la intervención y del responsable del Servicio.

6. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Las características mínimas del servicio a prestar son las siguientes:

- Servicio Asistencia Técnica con horario de 8:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.
- El tiempo máximo de respuesta (TMR) será de 24 horas. El TMR es el tiempo transcurrido desde la comunicación o recepción de la incidencia o avería del equipo o instalación a la Empresa Adjudicataria hasta que esta está en disposición de actuar sobre la misma.
- Disponibilidad de equipos de un 95% del tiempo útil. La Empresa Adjudicataria debe garantizar un porcentaje de disponibilidad del equipamiento objeto del contrato computándose en base a los días naturales de los 365 días anuales y calculando el porcentaje que representan las horas de parada total o parcial del equipo sobre las horas totales del periodo considerado, (8 horas de trabajo diario y 5 días a la semana excepto festivos) menos las dedicadas a mantenimiento preventivo.

Estarán incluidos todos los desplazamientos, dietas, materiales, transportes y cualquier medio humano o material necesario para la correcta ejecución de los trabajos descritos en el presente PPT.

La Empresa Adjudicataria realizará todos los trabajos indicados por el HCUVA para una correcta ejecución del contrato y coordinará los trabajos de forma que no afecten en ningún momento a la actividad asistencial del hospital.

7. PLAN DE FORMACIÓN

La Empresa Adjudicataria llevará a cabo una formación a los trabajadores sobre el funcionamiento y mantenimiento del equipamiento objeto de contrato. Esta formación se llevará a cabo a lo largo

del contrato, preferiblemente en los 6 primeros meses del mismo, en las fechas que se consideren adecuadas por ambas partes.

La Empresa Licitadora presentará en su Oferta Técnica programa de formación dirigido a los usuarios de los equipos, indicando tipo de formación, contenido, a quién va dirigido, número de horas y fecha prevista. Este plan podrá ser ampliado en función de las necesidades detectadas a lo largo del mismo.

8. MEDIOS PERSONALES, TÉCNICOS Y MATERIALES.

Para la realización de los trabajos objeto de este contrato, la Empresa Adjudicataria nombrará a un Responsable Técnico del contrato, con amplia experiencia en este tipo de mantenimiento, que ostente la representación de la empresa, lleve la coordinación, dirección técnica del presente contrato y preste el asesoramiento técnico legal sobre la totalidad de los equipos contratados. Se dispondrá de teléfono de localización del responsable asignado y deberá garantizar su presencia física in situ en menos de 24 horas dentro de la jornada laboral establecida de 8:00 a 18:00 horas.

La empresa Adjudicataria deberá aportar en su oferta técnica teléfono para la recepción de los avisos, y deberá dotar a sus técnicos de medios adecuados para su localización en la jornada laboral establecida.

La Empresa Adjudicataria incorporará personal técnico debidamente cualificado y acreditado, con una experiencia demostrable superior a 2 años en el mantenimiento de equipos de endoscopia. Por lo que presentará en su oferta técnica Currículum Vitae de las personas que vayan a desarrollar la prestación de este servicio.

La Empresa Adjudicataria aportará todos los materiales y repuestos necesarios para la realización de los trabajos objeto de esta contratación, ya que el precio de los mismos está incluido en el precio total del contrato.

Todos los materiales y repuestos necesarios para el desarrollo de los trabajos objeto de esta contratación deben ser idénticos en marca y modelo a los instalados.

La Empresa Adjudicataria debe disponer de los más avanzados equipos de diagnóstico y de todas aquellas herramientas, equipos de medida y control que sean necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades propias del contrato y que den plena garantía de los trabajos efectuados.

9. INFORME DEL SERVICIO

El Responsable Técnico del contrato deberá elaborar con carácter trimestral, dentro de los 10 primeros días del mes correspondiente, un informe donde se recogerán los trabajos y tareas ejecutadas de acuerdo con la organización del servicio.

Este informe tendrá una estructura fija y permanente y recogerá como mínimo datos relativos a la actividad. Trabajos realizados por Servicio, indicando tipos de mantenimiento, averías,

inspecciones preventivas, correctivas, sustituciones por reposición realizadas, actualizaciones de inventario, etc.

Este informe será básicamente una base de datos que resuma y refleje de forma clara y comprensible el estado y actuaciones realizadas sobre los distintos equipos.

La Empresa Licitadora adjuntará en oferta técnica la descripción y tipo de informe que utilizarán como Informe de Servicio, para el seguimiento del contrato. En cualquier caso, una vez firmado el contrato, el formato y contenido de dicho informe podrá ser modificado a propuesta del Hospital.

Murcia, a 14 de febrero de 2020



Fdo. Esther Pastor Romero
Ingeniero Técnico
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

ANEXO I

SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS.

INDICADORES DE FALLOS DE CALIDAD, DISPONIBILIDAD Y CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA.

El Servicio Murciano de Salud, está desarrollando un sistema de gestión informático, en adelante SGI, que permite la Gestión de los Servicios.

El Contratista del Servicio que resulte adjudicatario vendrá obligado a hacer el uso del SGI así como a gestionar por medio del mismo, la totalidad de las Incidencias y Fallos que se imputen al Servicio a su cargo. La gestión de los Indicadores, así como los procesos de registro, traslado, recepción, resolución y valoración económica que los gestionan, junto con las bases de datos que se generen en el proceso, conforman el SGI.

El modelo del SGI se basa, en sentido positivo, en el establecimiento de un conjunto de indicadores en el presente anexo que, aplicados al contenido del Programa del Servicio propuesto por el Contratista, evidencian el mantenimiento del nivel de calidad exigido cuando no se presentan incidencias que suponen el incumplimiento de los mismos.

El incumplimiento de los citados indicadores denota una situación incompatible con el nivel de calidad o disponibilidad exigible y comprometido por el contratista y determina la aparición de fallos de calidad (FC) y fallos de disponibilidad (FD) en una determinada zona, área o espacio que la convierte en inapropiada o inadecuada, total o parcialmente, para que en la misma se pueda prestar el servicio sanitario habitual a cargo del sistema público de salud.

En consecuencia, el modelo está basado en el cumplimiento de determinados indicadores que conectan directamente con la aplicación práctica del Programa del Servicio y de los Manuales y Protocolos de cada uno de los procesos implantados por el Contratista.

Cada uno de los fallos de calidad y disponibilidad tienen el coste económico que se recoge en este pliego. El coste combina y pone en relación la gravedad del fallo con la criticidad de la zona en la que se produce y parte de un valor económico cuya magnitud en euros se establece en el presente Anexo.

El SGI gestiona, entre otros aspectos, el conjunto de Indicadores que se relacionan en el presente anexo. Estos indicadores presentan una perspectiva en dos sentidos opuestos y diferenciados:

- En sentido positivo o de calidad, los indicadores actúan como indicadores del nivel de calidad que se exige en la prestación del Servicio. La ausencia de fallos es un signo de buena calidad en el Servicio.
- En sentido negativo o de fallos, los indicadores constituyen, cuando se incumplen, las referencias para el nacimiento y cómputo de los fallos de calidad o de disponibilidad. La presencia de fallos determina que los procesos de calidad no se están cumpliendo adecuadamente.

Transferencia del riesgo. De indicadores y fallos

Durante la ejecución del contrato, el contratista asumirá el riesgo operativo del servicio adjudicado, traducidos o representados mediante dos riesgos significativos: el riesgo de calidad y el riesgo de disponibilidad. Entonces, se medirá el grado de cumplimiento de la prestación pactada, por parte de aquél, a través de unos indicadores objetivos que para sendos riesgos se han estipulado.

Ambos indicadores, de calidad y de disponibilidad, se clasifican en leves, moderados o severos; ello, en base al nivel de gravedad de la situación a la que se han vinculado, existe un cuarto, denominado "solicitud de trabajo" que tiene un tratamiento especial que veremos más adelante. Vulnerar cualquiera de estos indicadores habilitará al Área de Salud para la apertura, a través de los portales y sistemas que más adelante se describen, de una incidencia de calidad o de disponibilidad.

La apertura de una incidencia podrá suponer la imputación, al contratista, de al menos un fallo de calidad o, de disponibilidad. Posteriormente, se profundiza en la asociación "indicador ↔ incidencia ↔ fallo/s".

Los indicadores de calidad aparecen en el Anexo I a este PPT, junto con su nivel de importancia o severidad. Los indicadores de disponibilidad se concretan, exclusivamente, en los tres que siguen:

- Leve. La actividad asistencial y/o administrativa aún permanece/n inalterada/s, pero puede/n ser menoscabada/s.
- Moderado. La actividad asistencial y/o administrativa se ha/n menoscabado, sin llegar a interrumpirse.
- Severo. Se ha/n interrumpido, parcial o totalmente, la actividad asistencial y/o administrativa.
- Solicitud de Trabajo. No es una pérdida de disponibilidad propiamente dicho, es una solicitud de actividad especial previamente pactada o incluida en el contrato que igualmente requiere de su control y establecimiento de acuerdo de nivel de servicio.

Por actividad asistencial ha de concebirse aquélla que es realizada por profesionales sanitarios. Por actividad administrativa, aquélla que es realizada por profesionales no sanitarios.

Se subraya que declarar impacto en la actividad asistencial y/o administrativa (indicadores de disponibilidad moderado y severo), será lícito aun cuando la causa de aquél se ubique en una zona en la que no se preste actividad alguna, tal como un aseo o una sala técnica en la que se hallen los climatizadores que den servicio, p. ej., a la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario

Dependencia de la zona asistencial

Grosso modo, parece lógico pensar que, entre otros factores, la zona asistencial en la que se vulnere un indicador graduará la consecuencia de la incidencia oportuna. A tal efecto, piénsese, p. ej., que en un quirófano el tiempo apremia; no tanto en una consulta o en un despacho administrativo.

Los centros han sido estructurados a efectos funcionales en las siguientes Áreas que se agrupan en función de su nivel de criticidad para la prestación del servicio sanitario:

UNIDAD	CLASIFICACION
Areas no detalladas	Bajo riesgo
Hospital de Día Quirúrgico	Critica
Unidad de Cuidados Intensivos	Critica
Urgencias	Critica
Bloque quirúrgico	Critica
Diálisis	Critica
Hemodinámica	Critica
Anatomía Patológica	Intermedia
Centros de Salud y Consultorios	Intermedia
Consultas Externas - Gabinetes	Intermedia
Consultas Hospital de día Quirúrgico	Intermedia
Diagnóstico por imagen	Intermedia
Hospital de Día Médico	Intermedia
Laboratorios	Intermedia
Radioterapia	Intermedia
Rehabilitación	Intermedia
Unidades de Hospitalización y otros puestos con pacientes encamados	Intermedia

Tiempo de corrección

El tiempo máximo al que, para la resolución de cualesquier incidencias, quedará sometido el contratista, será el resultado de conjugar la gravedad del indicador pertinente (leve, moderado o severo), con la importancia del área específica en la que éste se vulnere (Bajo riesgo, intermedia o crítica). Tiempo máximo conocido, habitualmente, como Tiempo de Corrección; o TC y por supuesto siempre dentro del horario aplicable al servicio.

El mapa de tiempos, en minutos, que de lo anterior resulta, es el siguiente:

		INDICADOR		
		SEVERO	MODERADO	LEVE
ZONA	CRITICA	15	60	240
	INTERMEDIA	60	240	960
	BAJO RIESGO	240	960	3840

Tiempos aplicables a fallos de calidad y a fallos de disponibilidad, siempre contando dentro del horario establecido del servicio, si el horario es de 24 horas no hay parada, el tiempo "corre" de forma continua, en el caso de 12 horas de servicio, una incidencia moderada no critica, deberá esperar a su resolución al día siguiente ya que supera las 12 horas del horario habitual.

Las solicitudes de trabajo se definen con periodo de tiempo muy superior, normalmente inferior a "15 días", dado que no es un fallo propiamente dicho, sino un trabajo contenido dentro de la prestación del servicio. Este tiempo puede ser configurado de forma particular a tipologías de solicitudes de trabajo partiendo inicialmente de no más de 15 días desde que se notifica.

Propiedad recursiva

Por tanto, mientras una incidencia no esté materialmente resuelta en ésta se computarán, como mínimo, tantos fallos como tiempos de corrección (TC) se transgredan. Como mínimo porque no habiendo transgredido el TC correspondiente, en el instante de apertura de una incidencia se podrá registrar un primer fallo si la causa que originó la vulneración del indicador en cuestión se debió a un incumplimiento, del contratista, de lo convenido.

La asociación "indicador ↔ incidencia ↔ fallo/s" puede derivar, pues, en múltiples escenarios. A saber:

¿INDICADOR VULNERADO A RAÍZ DE UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA?	INCIDENCIAS ABIERTAS	TIEMPO DE CORRECCIÓN	FALLOS COMPUTADOS
No	Una	No transgredido	Cero
		Transgredido una, o más veces	Tantos como TC transgredidos
Sí	Una	No transgredido	Uno, en el instante de apertura de la incidencia
		Transgredido una, o más veces	Tantos como [TC transgredidos + 1]

La resolución de incidencias es, en cualquier caso, imperativa.

Excepciones

La transferencia del riesgo al contratista, en las concretas circunstancias a continuación expuestas, será inviable, no siendo posible la apertura de incidencias cuando el contratiempo provenga:

- De actividades planificadas, conjuntamente con el Área de Salud y por éste aprobadas, con la suficiente antelación (superior a siete días naturales). Actividades a instancia del contratista.
- De casos de fuerza mayor, siempre que el contratista no haya actuado imprudentemente.
- De casos de conflicto colectivo, siempre que se salvaguarden los servicios mínimos pactados.
- De actuaciones ejecutadas por el Área de Salud o por proveedores cualesquiera por éste contratados.

Penalidad

El contratista, estará sujeto a penalización si la gestión de los avisos e incidencias incurre en fallos de disponibilidad y/o calidad. Esta penalización (económica) se calcula en base a estos fallos de calidad y/o de disponibilidad mensualmente, la cantidad (penalidad) que sigue:

$$P = UE \sum_{i=1}^{n+m} CTI_i \cdot CTZ_i \cdot f_i$$

En la expresión anterior:

P = Penalidad (euros).

UE = Unidad económica a aplicar en la deducción 29,926 Euros.

n = Incidencias de calidad abiertas y resueltas.

m = Incidencias de disponibilidad abiertas y resueltas.

CTI = Para la incidencia i, coeficiente por Tipo de Indicador. A saber:

	LEVE	MODERADO	SEVERO
CTI	1,00	2,00	4,00

CTZ = Para la incidencia i, coeficiente por Tipo de Zona. A saber:

	BAJO RIESGO	INTERMEDIA	CRÍTICA
CTZ	0,50	1,00	1,50

f = Número de fallos que la incidencia i integra.


El contratista tendrá la potestad de impugnar una incidencia ante la Comisión de seguimiento del contrato, entendiendo esta impugnación como su disconformidad ante la imputación de cierto incumplimiento de calidad o, disponibilidad.

De los Portales y Sistemas Existentes

El SMS emplea el paquete de planificación de recursos empresariales SAP, como software para la gestión asistida por ordenador. No obstante, ha desarrollado una aplicación, integrada con SAP, accesible vía web y con capacidad para el uso de herramientas de movilidad, notificación de acciones en tiempo real, SGI en adelante siendo esta válida para:

- Identificar el origen y las diferentes etapas por las que una incidencia, según el modelo que para el acuerdo de nivel de servicio se ha adoptado, transcurre.
- Calcular, automáticamente, la deducción económica que proceda.

A título ilustrativo, no excluyente ni limitativo, se resume la interrelación entre esos portales y sistemas, gráficamente como:

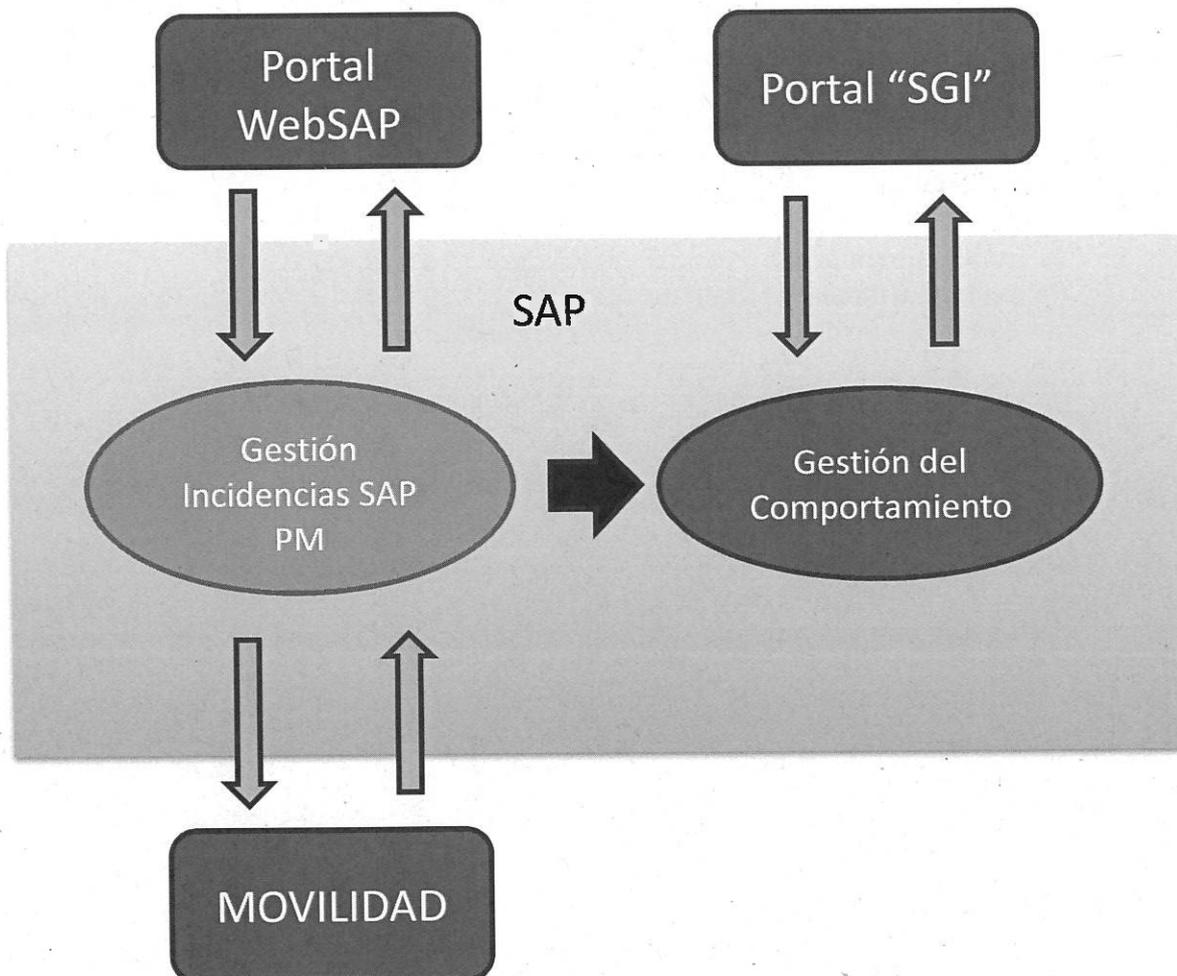

En principio, el contratista no dispondrá de acceso directo a SAP; ello, sin perjuicio de la información que deba suministrar, ordenadamente, para la confección y/u optimización de la base de datos de aquél. Sí quedará obligado al uso del SGI, cubriendo, permanentemente, la servidumbre que ello demande, y debiendo llevar a cabo las siguientes actuaciones:

- Formación de su personal en el SGI. El SMS proporcionará manuales y documentación varia de interés al efecto.
- Dotación de cuantos dispositivos informáticos, tanto fijos (ordenadores de sobremesa, impresoras, etc.) como móviles (smartphones, tablets, etc.), sean necesarios para la gestión asistida por ordenador fuera de la ubicación de trabajo dado que la WEB o portal es accesible y pública desde una portal seguro.

De las Impugnaciones y de la Comisión de seguimiento

Será la Comisión de seguimiento del contrato, que se reunirá con periodicidad trimestral o cuando se considere necesaria, la que revise el acuerdo de nivel de servicio.

A la Comisión de seguimiento asistirán responsables de ambas partes que garanticen:

- De requerirse, una explicación técnica de las razones que motivaron, bien la apertura de una incidencia impugnada, bien la disconformidad con el incumplimiento asociado. Se desprende, pues, que el contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.
- La resolución ejecutiva, por parte del Área de Salud/centro, acerca de la firmeza o desestimación de las impugnaciones realizadas por el contratista. La firmeza de una impugnación significará que ese servicio de salud considera la causa del incumplimiento como extrínseca a las responsabilidades del contratista, no conllevando penalidad alguna; la desestimación, lo contrario.

Resuelta una incidencia se notificará, de existir, la penalidad originada.

A partir de esa notificación, el contratista dispondrá de 72 horas naturales para, si así lo estima, impugnar, parcial o totalmente, tal incidencia. El SMS contestará en un plazo de 7 días la estimación o desestimación de la impugnación.

INDICADORES DE CALIDAD

En este apartado se recogen el conjunto inicial de Indicadores de Calidad junto con su criticidad, relacionados con el Programa del Servicio del contratista. Todos estos indicadores son una propuesta inicial para medir la calidad del Programa de Servicio, sirva este listado de forma genérica para relacionar los posibles fallos que pueda incurrir el adjudicatario durante la ejecución del contrato, pudiendo esta lista aumentar, cambiar o reducir en función de los detalles del Programa del Servicio que finalmente se adjudique.

Para la elaboración de los Indicadores ha realizado en primer lugar una clasificación de los mismos por grupos y categorías con el fin de dar un carácter lo más homogéneo posible al proceso de posterior evaluación de los mismos.

Así, se han agrupado en cinco grupos de referencia:

Grupo 1: Seguimiento del servicio.

Este grupo contempla los indicadores que velan por el cumplimiento de las condiciones de cada uno de los servicios.

Grupo 2: Actuaciones del servicio.

Este grupo contempla los indicadores que velan por el cumplimiento de los niveles de prestación o acuerdo de servicio, determinados en la oferta final del contratista.

Grupo 3: Estado de mantenimiento de las instalaciones o equipos.

Agrupar, en el caso de que aplique los indicadores que tienen relación con las instalaciones y/o equipos necesarios para la correcta prestación del servicio, así como la seguridad en su estado o utilización, tanto para los trabajadores del servicio como terceras personas.

Grupo 4: Gestión de Recursos Humanos.

Se agrupan los diferentes indicadores que hacen referencia a los procedimientos de gestión de personal de los diferentes servicios.

Grupo 5: Registros de cumplimiento y seguimiento.

Se agrupan aquí los indicadores que evalúan, la calidad y mejora continua, dentro de los sistemas de registro del cumplimiento y seguimiento de los servicios.

La tabla de Indicadores y su grado de Severidad podrá ser objeto de análisis, ajuste y determinación en la Comisión del Servicio, a propuesta de alguna de las partes. En la siguiente tabla se muestra el conjunto de indicadores por cada grupo junto con una breve descripción del mismo y su severidad asociada.

Código indicador calidad	Descripción	Severidad
01.01	Fallo de Calidad Leve en Cumplimiento de la Prestación del Servicio. Fallo PUNTUAL en algún elemento o requerimiento del cumplimiento del mismo.	LE
01.02	Fallo de Calidad Moderado en Cumplimiento de la Prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o requerimiento del cumplimiento del mismo.	MO
01.03	Fallo de Calidad Severo en Cumplimiento de la Prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o requerimiento del cumplimiento del Servicio que evidencia la NO IMPLANTACIÓN correcta de una o varias prestaciones del mismo ó pérdida de disponibilidad.	SE
02.01	Fallo de Calidad Leve en Cumplimiento de los NIVELES DE PRESTACIÓN del Servicio. Fallo PUNTUAL en algún elemento o requerimiento del cumplimiento de los niveles acordados para la Prestación del mismo.	LE
02.02	Fallo de Calidad Moderado en Cumplimiento de los NIVELES DE PRESTACIÓN del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o requerimiento del cumplimiento de los niveles acordados para la Prestación del mismo.	MO
02.03	Fallo de Calidad Severo en Cumplimiento de los NIVELES DE PRESTACIÓN del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o requerimiento del cumplimiento de los niveles acordados para la Prestación del Servicio que evidencia la NO IMPLANTACIÓN correcta de una o varias prestaciones del Servicio o pérdida de disponibilidad.	SE
03.01	Fallo de Calidad Leve en Cumplimiento de la dotación, uso y conservación del equipamiento para la prestación del Servicio. Fallo PUNTUAL en algún elemento o requerimiento del cumplimiento del Servicio en materia de dotación, uso y conservación del equipamiento asociado al mismo.	LE
03.02	Fallo de Calidad Moderado en Cumplimiento de la dotación, uso y conservación del equipamiento para la prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o requerimiento del cumplimiento del Servicio en materia de dotación, uso y conservación del equipamiento asociado al mismo.	MO

Código indicador calidad	Descripción	Severidad
03.03	Fallo de Calidad Severo en Cumplimiento de la dotación, uso y conservación del equipamiento para la prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o requerimiento del cumplimiento del Servicio en materia de dotación, uso y conservación del equipamiento asociado al servicio que evidencia la NO IMPLANTACION correcta de una o varias prestaciones asociadas al servicio o una pérdida de disponibilidad.	SE
04.01	Fallo de Calidad Leve en Cumplimiento de los Recursos Humanos y Formación para la prestación del Servicio. Fallo PUNTUAL en algún elemento o requerimiento del cumplimiento del Servicio en materia de RRHH y Formación asociado al mismo.	LE
04.02	Fallo de Calidad Moderado en Cumplimiento de los Recursos Humanos y Formación para la prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o requerimiento del cumplimiento del Servicio en materia de RRHH y Formación asociado al mismo.	MO
04.03	Fallo de Calidad Severo en Cumplimiento de los Recursos Humanos y Formación para la prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o requerimiento del cumplimiento del Servicio en materia de RRHH y Formación asociado al mismo que evidencia la NO IMPLANTACION correcta de una o varias prestaciones asociadas al servicio o una pérdida de disponibilidad.	SE
05.01	Fallo de Calidad Leve en Cumplimiento de los Planes de Calidad y Mejora Continua a implantar dentro de la Prestación del Servicio. Fallo PUNTUAL en algún elemento o requerimiento del cumplimiento de estos planes implementados para la calidad y mejora continua asociados al mismo.	LE
05.02	Fallo de Calidad Moderado en Cumplimiento de los Planes de Calidad y Mejora Continua a implantar dentro de la Prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o requerimiento del cumplimiento de estos planes implementados para la calidad y mejora continua asociados al mismo.	MO
05.03	Fallo de Calidad Severo en Cumplimiento de los Planes de Calidad y Mejora Continua a implantar dentro de la Prestación del Servicio. Fallo REPETITIVO en algún elemento o requerimiento del cumplimiento de estos planes implementados para la calidad y mejora continua asociados al mismo que evidencia la NO IMPLANTACION correcta de una o varias prestaciones asociadas al servicio o una pérdida de disponibilidad.	SE

MODELO DE ESTADOS DE INCIDENCIA.

A modo descriptivo el procedimiento de registro de las Incidencias e imputación de fallos de calidad en el SGI será el siguiente:

- a) **Activación.** El Personal del centro afectado, o que esté habilitado para ello, mediante Incidencias Puntuales (IP) o Incidencias de Supervisión (IS), dará de alta en el SGI o WEBSAP los avisos que procedan. El SGI registrará la activación de la Incidencia e identificará todos los elementos que permitan su localización y corrección.
- b) **Datos identificativos de la Incidencia.** SGI/WEBSAP registrará los datos de la persona que activa la incidencia, la fecha y hora en que se ha detectado, zona afectada, síntoma o problema detectado (enlaza con indicador) y su nivel de gravedad y producirá un aviso que llegará a los terminales del Contratista del Servicio para que proceda a su corrección inmediata y siempre dentro del plazo máximo señalado para ello en la Tabla de TRC.
- c) **Aceptación o Rechazo:** El contratista dispondrá de la posibilidad de rechazar el aviso en el supuesto de que por error se le haya asignado de forma incorrecta y el personal asignado por parte del centro para la revisión de estos problemas esté de acuerdo. Los Rechazos serán siempre revisados por este personal específico para verificar los mismos. La detección por parte de la comisión de seguimiento del contrato de un uso indebido de esta herramienta u opción de "rechazo" puede acarrear la retirada o eliminación de esta opción y la penalización correspondiente dentro de los indicadores/fallos de calidad correspondiente.
- d) **Cierre Avisos:** Subsano el aviso, el contratista cerrará el mismo siendo evaluado por el usuario que ha abierto el mismo y respondiendo de forma satisfactoria o no al cierre. En caso de no ser satisfactorio el aviso será reabierto, y computará el TC desde el comienzo del aviso original generando de nuevo fallos de calidad o disponibilidad.
- e) **Generación de Fallos y Conformidad o disconformidad.** Subsano el fallo y corregida la incidencia y tras evaluar la naturaleza, el origen de la incidencia y determinar el coste económico del fallo, el Contratista podrá mostrar su conformidad o disconformidad con la imputación del fallo. Transcurridas 24 horas desde el cierre por resolución del fallo, el SGI lo dará por cerrado y por conforme.
- f) **Efectos de la conformidad.** Si el Contratista del Servicio (contratista) no manifiesta por medio del SGI su disconformidad motivada, en el plazo máximo de 72 horas desde que el fallo haya sido objeto de cierre y valoración, el fallo y su valoración económica será imputado al Servicio.
- g) **Efectos y procedimiento de disconformidad.** Si el Contratista del Servicio no está conforme con la imputación del fallo y consiguiente deducción, lo hará constar expresamente en las 72 horas siguientes al momento de cierre del mismo.

ANEXO II

TORRES

TORRE UROLOGIA HD - Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	PEDAL	K. STORZ	
1	Cold Light Fountain, XENON NOVA 300 lamp type: 300 W XENON lamp power supply: 100-125VAC /220-240VAC; 50/60 Hz	K. STORZ	1100005133
1	AUTOCON®II 400 High End Supply voltage: 230 VAC, 50/60 Hz HF-Connecting Sockets: Bipolar Standard Bipolar multi function Unipolar 3-Pin + Erbe Neutral elektrode 6,3 mm jack consists of: 20535220-115 AUTOCON®II 400 mit KARL STORZ SCB®, 400A mains cord 20090170 SCB connection cable, length 100 cm system requirements: SCB R-UI Software Release 20090001-26	K. STORZ	1100005134
1	PETACA	K. STORZ	
1	MODULO DE CAMARA	K. STORZ	1100005132
1	CABEZAL DE CAMARA	K. STORZ	
1	ENDOFLATOR	K. STORZ	1100005135
1	24" HD TFT Flat screen	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	1100004179

TORRE TORACOSCOPIA-Q CVV

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Monitor Plano 3D de 32"	K. STORZ	
1	Fuente de luz Xenon 300 W.	K. STORZ	
1	Video-Laparoscopia 3D, mod. TIPCAM 10 mm., visión 30º	K. STORZ	
1	Unidad CCU Image1 S CONNECT	K. STORZ	
1	Módulo 3D IMAGE1 S D3-LINK	K. STORZ	
1	Carro abierto para equipo 3D	K. STORZ	

TORRE Q7- HD

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cold Light Fountain, XENON NOVA 300 lamp type: 300 W XENON lamp power supply: 100-125VAC /220-240VAC; 50/60 Hz	K. STORZ	32191
1	IMAGE 1 HUB	K. STORZ	30579
1	CABEZAL DE CAMARA HD	K. STORZ	
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	30583
1	24" HD TFT Flat screen	K. STORZ	30586
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	S/N
1	DVD	SONY	30582

MONITOR SATELITE

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	24" HD TFT Flat screen	K. STORZ	
1	MOVIL STAND- SOPORTE	K. STORZ	

TORRE UROLOGIA RTU

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Fuente De Luz Fría Xenon Nova Con De 175 W Xenon, Tensión De Servicio 100-125/220-240 Vac, 50/60 Hz, In 400 A Cable De Corriente	K. STORZ	10346
1	TELECAM SL	K. STORZ	1100005460
1	Cabeza De Cámara Telecam Beamspli Sistema De Color: Pal Con Sensor Ccd Rotatorio, F=30 Mm	K. STORZ	
1	ENDOFLATOR	K. STORZ	1100005459
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	

1	DVD	SONY	1100005458
1	Monitor SONY - 20" - Tubo	SONY	1100005461

TORRE CIRUGIA Q6

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	BRAZO SOPORTE - ERGOTRON	K. STORZ	
1	Cold Light Fountain,XENON NOVA 300lamp type: 300 W XENON lamp power supply:100-125VAC /220-240VAC; 50/60 Hz	K. STORZ	30584
1	Cabezal - Tricam	K. STORZ	
1	TRICAM SL II	K. STORZ	32187
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	32188
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	DVD	PANASONIC	32190
1	Panel Plano 18" - Vga	K. STORZ	1100005454
1	Pantalla plana 21"	SONY	1100005462

EQUIPO DE RESERVA - ESTANTERIA DE ALMACEN

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CABEZAL DE CAMARA TELECAM	K. STORZ	0695
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	1435

TORRE EMERGENCIAS

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	MONITOR	PHILIPS	1100005457
1	DIGIVIDEO	K. STORZ	1437
1	TELECAM	K. STORZ	16580
1	Cabeza De Cámara Telecam, Sistema Color Pal, Con Zoom Parafoval Int F=25-50 Mm	K. STORZ	
1	LAPAROFILATOR	K. STORZ	2023
1	FUENTE DE LUZ XENON	K. STORZ	0696
1	DVD	JVC	1100005456

TORRE NEURO STORZ

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	FUENTE DE LUZ XENON	K. STORZ	
1	DIGIVIDEO	K. STORZ	16565
1	TELECAM	K. STORZ	
1	Cabeza De Cámara Telecam, Sistema Color Pal, Con Zoom Parafoval Int F=25-50 Mm	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	DVD	OTROS	
1	Pantalla plana 21"	SONY	217001-2

TORRE ARTROSCOPIO ANTIGUA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	OBTURADOR	K. STORZ	
1	Vaina Para Artroscopio, Diámetro 5.5 Mm, Longitud 12 Cm, Provista De Dos Llaves, Giratorias, Para Utilizar Con Los Telescopios Hopkins De 0°, 30°, 70° Y 90°, Código De Color: Verde-Rojo- Amarillo	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	

TORRE DE FIBROSCOPIO CONSULTAS ORL - ANTIGUA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CABLE DE LUZ	OTROS	
1	Rhino-Pharyngo-Laryngo-Fiberscope Direction of view: 0° Angle of view: 70° Working length: 30 cm O.D.: 3.5 mm Following accessories are included: 27677 RR Case 11025 E Pressure Compensation Cap 13242 XL Leakage Tester	K. STORZ	

1	FUENTE DE LUZ	K. STORZ	
1	CCU DXCAM	K. STORZ	1672
1	CABEZAL DX	K. STORZ	
1	MONITOR DE TUBO	SONY	

TORRE DE FIBROSCOPIO CONSULTAS ORL - ANTIGUA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
3	FOTOFORO	K. STORZ	32103
1	RINO-LARINGOFIBROSCOPIO 23x5,2	K. STORZ	
1	VIDEO ENDOSCOPIO	K. STORZ	1100004201
1	VIDEO ENDOSCOPIO	K. STORZ	1100002822
1	OPTICA HOPKINS 30º - 4 MM	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS 70º - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS 0º - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS 0º - 4mm.	K. STORZ	
1	MONITOR	K. STORZ	1100004201
1	MONITOR	K. STORZ	1100002822
1	MONITOR		

TORRE QUIROFANO URGENCIAS

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	FUENTE DE LUZ LED	K. STORZ	1100004156
1	IMAGE 1 HUB	K. STORZ	
1	CABEZAL DE HD	K. STORZ	
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	1100005480
1	24" HD TFT Flat screen	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	DVD	PANASONIC	1100005483

TORRE QUIROFANO MATERNAL-INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	AIDA	K. STORZ	1100005493
1	Cabezal - Tricam	K. STORZ	
1	TRICAM CCU	K. STORZ	1100005496
1	Elemento Calefactor Optitherm Con Cable De Conexión, Esterilizado	K. STORZ	
1	ENDOFLATOR	K. STORZ	15647
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	5492
1	MONITOR	K. STORZ	
1	MONITOR	LG	1100005494

TORRE A QUIROFANO MAT. INF

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	AIDA	K. STORZ	100005488
1	FUENTE DE LUZ XENON 300W	K. STORZ	06283
1	Cabezal - Tricam	K. STORZ	
1	TRICAM SL	K. STORZ	1100005485
1	Elemento Calefactor Optitherm Con Cable De Conexión, Esterilizado	K. STORZ	
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	1100005487
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	1100005484
1	MONITOR	LG	1100004041

TORRE C QUIROFANO MAT. INF

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	AIDA	K. STORZ	1100005499
1	FUENTE DE LUZ XENON 300W	K. STORZ	1100005505
1	Cabezal - Tricam	K. STORZ	
1	TELECAM DX II 1-Chip Camera Control Unit (CCU), with integrated electronic Fiberscope Filters, Color System: PAL/NTSC, Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz	K. STORZ	1100005491
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	06286
1	Elemento Calefactor Optitherm Con Cable De Conexión, Esterilizado	K. STORZ	
1	ENDOMAT	K. STORZ	1100005498
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	1100005495
1	MONITOR	LG	1100005500

TORRE ANESTESIA INTUBACION DIFICIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	MONITOR	SONY	30326
1	FIBROSCOPIO DE INTUBACION - 5 x 65	K. STORZ	
1	FUENTE DE LUZ XENON NOVA	K. STORZ	28882
1	Cabeza De Cámara Telecam Con Mont Sistema De Color Pal	K. STORZ	
1	TELECAM DX	K. STORZ	28881
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	26663

TORRE CONSULTA MAXILOFACIAL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	XENON NOVA	K. STORZ	
1	TELECAM SL	K. STORZ	
1	Cabeza De Cámara Telecam, Sistema Color Pal, Con Zoom Parafoval Int F=25-50 Mm	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	DVD	SONY	
1	MONITOR	K. STORZ	

QUIROFANO 5 INTEGRADO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	INTERFACE 2 - AIDA	K. STORZ	
1	AIDA	K. STORZ	
1	OR1-CONTROL	K. STORZ	
1	MONITOR	K. STORZ	6269
1	FUENTE DE LUZ	K. STORZ	1100005486
1	MORCELADOR	K. STORZ	1100005507
1	ENDOMAT	K. STORZ	6285
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	1100005506
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	6271
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	6270

1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	6268
1	MONITOR 42"	SONY	6287
1	MONITOR	LG	6282
1	DVD	SONY	

QUIROFANO 2 INTEGRADO

QTY	DESCRIPCIÓN		Nº INV.
1	MONITOR	K. STORZ	6272
1	XENON 300	K. STORZ	6278
1	Cabezal - Tricam	K. STORZ	
1	IMAGE 1 HUB	K. STORZ	6279
1	CABEZAL DE CAMARA	K. STORZ	
1	ENDOMAT	K. STORZ	6247
1	THERMOFLATOR	K. STORZ	6276
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	6275
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	6274
1	19" Flat Screen Monitor, Wall Mounted with VESA 100 mounting, Color System PAL/NTSC Resolution max. 1280 x 1024 SDI, Composite, S-Video RGB, DVI and S-XGA Input Brightness: 450cd/m2 Contrast: 650:1 Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz consisting of: 9419NG 19" TFT Flat Screen 9419 PS Power Supply 400A Mains Cord	K. STORZ	6773
1	MONITOR 42"	K. STORZ	6280
1	MONITOR	LG	6281

QUIROFANO 2 INTEGRADO MEDIA CONTROL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	AIDA INTERFACE	K. STORZ	
1	AIDA CONTROL	K. STORZ	
1	OR1-CONTROL	K. STORZ	
1	DVD	SONY	

TORRE CONSULTA UROLOGIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	XENON NOVA	K. STORZ	
1	Cabeza De Cámara Telecam Con Mont Sistema De Color Pal	K. STORZ	
1	TELECAM DX II 1-Chip Camera Control Unit (CCU), with integrated electronic Fiberscope Filters, Color System: PAL/NTSC, Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz	K. STORZ	32214
1	MONITOR	LG	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 3.5 Mm, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	MONITOR	LG	

TORRE HISTEROSCOPIA 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	FUENTE DE LUZ	K. STORZ	15648
1	TELECAM	K. STORZ	
1	TELECAM SL	K. STORZ	
1	Cabeza De Cámara Telecam, Sistema Color Pal, Con Zoom Parafocal Int F=25-50 Mm	K. STORZ	

1	ENDOMAT	K. STORZ	07693
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	Monitor plano TFT 14" SONY	K. STORZ	
1	MONITOR	K. STORZ	
1	DVD	SONY	32717
1	VIDEO CASSETE	SONY	

TORRE HISTEROSCOPIA 2- CONSULTAS EXTERNAS MAT.

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	AIDA	K. STORZ	
1	Cold Light Fountain, XENON NOVA 300 lamp type: 300 W XENON lamp power supply: 100-125VAC /220-240VAC; 50/60 Hz	K. STORZ	31943
1	Cabeza De Cámara Telecam, Sistema Color Pal, Con Zoom Parafoval Int F=25-50 Mm	K. STORZ	
1	TELECAM SL II 1-Chip Camera Control Unit (CCU), with integrated Image Processing Modul, Color System: PAL/NTSC, Power Supply: 100-240 VAC, 50/60 Hz	K. STORZ	
1	ENDOMAT	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto	K. STORZ	
1	DVD	SONY	
1	MONITOR	LG	
1	MONITOR	SONY	15644

TORRE QUIROFANO 8

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pedal Doble, Dos Plataformas, Con Función Proporcional.	K. STORZ	
1	Pedal Simple, Para Usar Con Unida Alta Frecuencia Karl Storz Autoco 350, Para Control De Coagulación	K. STORZ	
1	XENON 300	K. STORZ	1100005470
1	TELECAM	K. STORZ	1100005466
1	AUTOCON 50	K. STORZ	31046
1	UNIDRIVE II PLUS	K. STORZ	1100005469
1	CAMARA	SONY	1100005467
1	HDD DISCO DURO	OTROS	
1	MONITOR	SONY	1100005456

INSTRUMENTAL LAPAROSCOPIA

QUIROFANO 1 LAPARO - BANDEJA EXTRA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
2	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

HIGADO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
-----	-------------	-------	---------

1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS DE KOH	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat Según Duval, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33500 Tubo Exterior Aislado 33510 Du Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat An Ángulo Recto, Mandíbulas De Do Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33500 Tubo Exterior Aislado 33510 Rg Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat Fenestrada, Mandíbulas De Doble A Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33500 Tubo Exterior Aislado 33510 Th Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

11

CAJA LAP. AZUL - Q3

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	R. WOLF	
1	PINZA COAGULACION	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33125 Mango Metálico Aislado Sin 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	

CESTILLO LAP - Q3

QTY	DESCRIPCIÓN		Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 4.8 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	

CESTILLO LAP 2- UROLOGIA Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
-----	-------------	-------	---------

1	Telescopio De 0° Hopkins li De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Cable de H.F., 3m.	K. STORZ	

TORACOCOSPIA I - Q7

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins li De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins li De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Click Line Pinzas de agarre universales	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

TORACOCOSPIA II - Q7

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins li De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Doble C Con Múltiples Dientes Mandíbula A Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 D Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

COLOPROCTOLOGIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins li De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS DE KOH	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
3	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

CAJA NISSEN - PROF. PARRILLA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
-----	-------------	-------	---------

1	Telescopio De 0° Hopkins li De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins li De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS DE KOH	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Disección "Dolphin Nose" Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Dn Terminal De Pinza	K. STORZ	
2	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

CAJA NISSEN - QUIROFANO 6

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins li De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins li De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS DE KOH	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Disección "Dolphin Nose" Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Dn Terminal De Pinza	K. STORZ	
2	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA UROLOGIA Q 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CESTA	OTROS	
1	Telescopio De 0° Hopkins li De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins li De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	

1	PINZA	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS	K. STORZ	
1	Pinza De Disección Click-Line, Ro Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Angulo Recto. Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 R Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

OPTICAS QUIROFANO Q6

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
2	Telescopio De 30° Hopkins Ii De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	OPTICA RECTOSCOPIA 0°	K. STORZ	
1	Óptica HOPKINS@II 30°, 5 mm, 29 cm	K. STORZ	

RESERVA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	Cable De Alta Frecuencia Para In- Strumentos Bipolares Karl Storz Para Uso Con Coagulador Karl Storz 26020 Xa/Xb, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Cable De Alta Frecuencia Para In- Strumentos Bipolares Karl Storz Para Uso Con Coagulador Karl Storz 26020 Xa/Xb, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	INSERTO	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre De Intestino Grue Rotatoria, 5 Mm, 36Cm, Fenestrada, Mandíbula Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33300 M Tubo Exterior Metálico 33310 C Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 43 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33400 Tubo Exterior Aislado 33410 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
2	Pinza De Agarre Y Disección Johan Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 43 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33400 Tubo Exterior Aislado 33410 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	INSERTO	K. STORZ	
2	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

MATERIAL RESERVA Q- MATERNO INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	DEFLECTOR PRISMATICO DE LUZ	K. STORZ	

1	Adaptador Fluvog Con Ventanilla Para Observación, Tapón Obturador Con Junta De Goma Y Ventanilla Con Escotadura	K. STORZ	
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Obturador, Para Utilizar Con La Vaina 26040 Sl, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	OPTICA RECTOSCOPIA 0°	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo (También Para Emplear Con El Uretrotomo Óptico) Corte Por Acción De Resorte . La Anilla Para El Pulgar Es Móvil. En La Posición De Reposo, El Asa Estará Situada Dentro De La Vaina	K. STORZ	
2	Vaina Para Resectoscopios, Incluy Tubos De Entrada Y Salida, 26 Fr. Con Aislamiento Cerámico, Rotator Con Elementos De Trabajo 27040 C/ 27050/C/D/E/En, Código De Color:	K. STORZ	
1	Mango De Plástico, Sin Retención Para Coagulación Monopolar.	K. STORZ	
4	Mango De Plástico, Con Retención Con Conector Para Coagulación Mon	K. STORZ	
1	Tubo Exterior Aislado, Con Conect Para Limpieza, 5 Mm, Long. 36 Cm	K. STORZ	
1	Inserción Para Pinzas	K. STORZ	
1	Terminal De Pinza Manhes, Mandíbu Múltiples Dientes, Ancho Mandíbul	K. STORZ	
1	Terminal De Pinza Manhes, "Tiger-	K. STORZ	
1	Mango de anillos RoBi®	K. STORZ	
1	Mango de anillos RoBi®	K. STORZ	
1	Vaina exterior metálica RoBi®, aislada	K. STORZ	
1	Inserto de pinzas RoBi®	K. STORZ	
1	Inserto de pinzas RoBi®, pinz. de agarre	K. STORZ	
1	HOPKINS Straight Forward Tele-scope 0°, diameter 2.7 mm, length 18 cm, autoclavable. Fiber opticlight transmission incorporated. Color code: green	K. STORZ	

LAP. QUIRURGICA MAT -1 cesta

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

CAJA 3 LAP. Q. URGENCIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, 2X3 Dientes, Mandíbu Acción Simple, Traumática. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Fm Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
1	CABLE MONOPOLAR	K. STORZ	

CAJA 2 LAP. Q. URGENCIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA UROLOGICA Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins Ii De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	KOH Macro Needle Holder, ergonomic axial handle with disengageable ratchet, ratchet release on the right side, left curved jaws, ø 5 mm, length 33 cm	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS	K. STORZ	
1	Pinza De Disección Click-Line, Ro Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Angulo Recto. Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 R Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Disección Click-Line, Ro Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Angulo Recto. Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 R Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA UROLOGICA 2 Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Con En- Chufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS	K. STORZ	
1	Pinza De Disección Click-Line, Ro 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Angulo Recto. Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33300 M Tubo Exterior Metálico 33310 R Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA ESPECIAL Q 6

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins Ii De Visión Frontal De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS DE KOH	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	

1	Pinza De Disección "Dolphin Nose" Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Dn Terminal De Pinza	K. STORZ	
3	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Dimensiones In 520 X 246 X 120 Mm Consistente En: 39301 Ja Parte Inferior 39301 Jb Tapadera 39301 Je Alfombrilla De Silicona	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

MATERIAL SALA DE DOCENCIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	TELEPACK	K. STORZ	
1	Fuente De Luz Fría Halogen 250 Tw Tensión De Servicio: 100/120/230/ 50/60 Hz	K. STORZ	
1	MODULO DE CAMARA	K. STORZ	
1	CABEZAL DE CAMARA	K. STORZ	
1	CABEZAL DE CAMARA	K. STORZ	
1	Cabeza De Cámara Telecam Con Mont Sistema De Color Pal	K. STORZ	
1	MODULO DE CAMARA	K. STORZ	
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Porta-Agujas «Pico De Papagayo» Según Szabo-Berci, Mango Recto, Con Enclavamiento, Para Uso Con Trócares De Tamaño 6 Mm	K. STORZ	
1	PORTA AGUJAS DE 5mm - KOH	K. STORZ	
2	Trainer Para Laparoscopia Según Szabo-Berci-Sackier, Con Placa De Cubierta Para "Sutura", Para Técnicas De Sutura Avanzadas	K. STORZ	
1	Trócar, Tamaño 13 Mm, Código De Color: Negro, Consta De: 30107 P Mandril De Trócar, Con Punta Triangular 30107 M Cánula De Trócar Con Válvula Multifuncional Y Llave Para La Insufla- Ción, Longitud 11.5 Cm	K. STORZ	
1	Trocar, Tamaño 6 Mm, Codigo De Color: Negro, Consta De: 30160 P Mandril De Trócar, Con Punta Triangular 30160 H2 Cánula, Sin Válvula, Tamaño 6 Mm, Longitud 10.5 Cm 30160 M1 Válvula Multifuncional Tamaño 6 Mm	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33121 Mango De Plástico, Sin Rete 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Manhe Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, "Duck-Bill- Jaws", At Mandíbulas De 10 Mm De Long. Acci Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Ms Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Johan Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 43 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33400 Tubo Exterior Aislado 33410 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

QUIROFANO URGENCIAS - CAJA 4

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
1	GANCHO	K. STORZ	

QUIROFANO URGENCIAS - CAJA 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	

QUIROFANO MATERNAL - CAJA LAPARO -INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

QUIROFANO MATERNAL - CAJA LAPARO -INFANTIL 5 MM

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Con En- Chufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	OPTICA RECTOSCOPIA 0°	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	GANCHO	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA NISSEN INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Óptica HOPKINS®II 30°, 5 mm, 29 cm	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

CAJA LAPAROSCOPIA NEONATAL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	GRIFO	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración E Irrigación, Superficie Mate, Con Llave De Dos Vías Para Manejo Con Una Sola Mano	K. STORZ	
1	PALPADOR	K. STORZ	
1	PALPADOR	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	INSERTO	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Con En- Chufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Cable De Alta Frecuencia Para In- Strumentos Bipolares Karl Storz Para Uso Con Coagulador Karl Storz 26020 Xa/Xb, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Manhes Click-Line Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Múltip De 4.8 Mm De Ancho Y Acción Simpl Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Me Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Manhes Click-Line Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, "Tiger-Jaw", 2X4 Die De Acción Simple Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Mg Terminal De Pinza	K. STORZ	

1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Tijeras Click-Line, Rotatorias, 5 Con Conector Para Coagulación Mon Cuchillas De 17 Mm Curvas, Mandíb Doble Acción Consistente En: 33125 Mango Metálico Aislado Sin 33300 Tubo Exterior Aislado 34310 Ma Terminal De Tijera	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA 2

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
1	CANULA UTERINA	K. STORZ	

LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA 3

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 0° Hopkins Ii De Visión Rectilínea De Gran Imagen, Diámetro 10 Mm, Longitud 31 Cm, Apto Para Autoclave, Con Conduc- Tor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Verde	K. STORZ	
2	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
1	Cánula Uterina Según Cohen, Con U Y Otro Pequeño, Fijación Para Usa Con Adaptador Luer-Lock Para Limp	K. STORZ	

MANIPULADOR UTERINO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	MANIPULADOR UTERINO CLERMONT	K. STORZ	

QUIROFANO MATERNAL PORTA 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	KOH Macro Needle Holder, ergonomic axial handle with disengageable ratchet, ratchet release on the right side, left curved jaws, ø 5 mm, length 33 cm	K. STORZ	
1	KOH Macro Needle Holder, ergonomic axial handle with disengageable ratchet, ratchet release on the left side, right curved jaws, ø 5 mm, length 33 cm	K. STORZ	
1	Anudador Extracorpóreo Según Cler 5 Mm, Long. 36 Cm	K. STORZ	
1	ANUDADOR EXTRACORPOREO	K. STORZ	

QUIROFANO MATERNAL PORTA 2

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Anudador Extracorpóreo Según Cler 5 Mm, Long. 36 Cm	K. STORZ	
1	ANUDADOR EXTRACORPOREO	K. STORZ	

MATERIAL SUELTO GINECOLOGIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Mecanismo De Cierre Subcutáneo De	K. STORZ	
1	Mecanismo De Cierre Subcutáneo De	K. STORZ	
1	PORTA-AGUJAS DE KOH	K. STORZ	
1	PORTA AGUJAS DE 5mm - KOH	K. STORZ	
1	Pinzas Para Coagulación Bipolar Take-Apart, Tamaño 5 Mm, Longitud 33 Cm, Constan De: 26176 Hr Mango 26176 Hsx Vaina Exterior 26176 Ht Suplemento De Pinzas	K. STORZ	
1	Mango bipolar con anillos	K. STORZ	
1	Click Line Pinzas de agarre universales	K. STORZ	

1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 36 Cm, 2X3 Dientes, Mandíbu Acción Simple, Traumática. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Fm Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Manhes Click-Line Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, "Tiger-Jaw", 2X4 Die De Acción Simple Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 Mg Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Kelly Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Doble Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33300 Tubo Exterior, Aislado 33310 MI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat 5 Mm, 36 Cm, 2X3 Dientes, Mandíbu Acción Simple, Traumática. Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33300 M Tubo Exterior Metálico 33310 Fm Terminal De Pinza	K. STORZ	
2	Pinza De Agarre Click-Line, Rotat 5 Mm, 36 Cm, 2X3 Dientes, Mandíbu Acción Simple, Traumática. Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33300 M Tubo Exterior Metálico 33310 Fm Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Manhes Click-Line 5 Mm, 36 Cm, Mandíbulas De Múltip De 4.8 Mm De Ancho Y Acción Simpl Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33300 M Tubo Exterior Metálico 33310 Me Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Rotatoria, 5 Mm, 36 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenció 33300 M Tubo Exterior Metálico 33310 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Johan Rotatoria, Con Conector Para Coag 5 Mm, 43 Cm, Atraumática, Mandíbu Acción Simple. Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33400 Tubo Exterior Aislado 33410 On Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Y Disección Reddi Click-Line, Rotatoria Con Conector Para Coagulación Mon 5 Mm, 43 Cm, Fuerte, Mandíbulas D Consistente En: 33122 Mango Plástico Con Retenció 33400 Tubo Exterior Aislado 33410 UI Terminal De Pinza	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Porta-agujas	K. STORZ	

CAJA MORCELADOR

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	Cánula Uterina Según Cohen, Con U Y Otro Pequeño, Fijación Para Usa Con Adaptador Luer-Lock Para Limp	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Hollow shaft-motor for ROTOCUT G1 26713001/26713101/26713002/26713201/26713301/26713202 for use with KARL STORZ UNDRIVE GYN 20711120 Maintenance of the motor driven components (EC motors, handles, shaverhandpieces) must be performed with universal Spray 280052 B+C (not longer scope of delivery). Please order separately.	K. STORZ	
1	Handle, for laparoscopic applications, length 9 cm, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713101/26713002	K. STORZ	
1	Obturator with pyramidal tip, diameter 12mm, for laparoscopic applications, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713002	K. STORZ	
1	Cutter, diameter 12mm, for laparoscopic applications, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713002	K. STORZ	
1	Trocarbush, askew, diameter 12mm, for laparoscopic applications, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713002	K. STORZ	
1	Obturator with pyramidal tip, diameter 15mm, for laparoscopic applications, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713002	K. STORZ	
1	Cutter, diameter 15mm, for laparoscopic applications, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713002	K. STORZ	
1	Trocarbush, askew, diameter 15mm, for laparoscopic applications, for use with ROTOCUT G1 26713001/26713002	K. STORZ	
1	Electrodo De Coagulación En Forma Mangeshikar, 5 Mm, Long. 36 Cm	K. STORZ	

2	Pinza De Tejidos Click-Line, 10 M Según Sawahle, Mandíbulas Doble A Consistente En: 33132 Mango Metálico Con Retenci3 33500 Tubo Exterior Aislado 33510 Um Terminal De Pinza	K. STORZ	
---	--	----------	--

MOTOR Y FRESAS Q 8

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	MOTOR	K. STORZ	
2	MOTOR INTRA - ANGULADO	K. STORZ	
1	MOTOR INTRA - ANGULADO	K. STORZ	
1	MANGO INTRA RECTO - 14cm.	K. STORZ	
1	MANGO INTRA RECTO - 14cm.	K. STORZ	
1	MANGO INTRA RECTO - 14cm.	K. STORZ	

INSTRUMENTAL UROLOGIA

QUIROFANO GINECOLOGIA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio Hopkins Foroblícuo De De Diámetro, Long. 30 Cm, Autocla Transmisión De Luz Por Fibra Ópti Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Puente Telescópico De Exploración	K. STORZ	
1	Vaina Para Cistoscopio- Uretroscopio, 17 Charr., Paso Para Catéter 5 Charr., Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Obturador Para Vaina 27026 U	K. STORZ	

RESECTOR HISTERO GINECARE

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	S	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

RESECTOR RUDOLF

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Vaina Para Resectoscopios, Incluy Tubos De Entrada Y Salida, 26 Fr. Con Aislamiento Cerámico, Rotator Con Elementos De Trabajo 27040 C/ 27050/C/D/E/En, Código De Color:	K. STORZ	
3	Cable De Alta Frecuencia Con Enchufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

RESECTOR GINE

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Vaina Para Resectoscopios, Incluy Tubos De Entrada Y Salida, 26 Fr. Con Aislamiento Cerámico, Rotator Con Elementos De Trabajo 27040 C/ 27050/C/D/E/En, Código De Color:	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo (También Para Emplear Con El Uretrotomo Óptico) Corte Por Acción De Resorte . La Anilla Para El Pulgar Es Móvil. En La Posición De Reposo, El Asa Estará Situada Dentro De La Vaina	K. STORZ	
1	Cable De Alta Frecuencia Con Enchufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	

UROLOGIA INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	OPTICA 0°	K. STORZ	
1	OPTICA 30°	K. STORZ	
1	OPTICA DE ENSEÑANZA	K. STORZ	

CISTOSCOPIO INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Óptica HOPKINS 30°, 1.9mm, 10cm	K. STORZ	
1	Telescopio De 0° Hopkins, Diámetr 1.9/2.1 Mm.Autoclavable, Con Tran De Luz Por Fibra Óptica Incorpora Código De Color: Verde.	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins, Diámet 1.9/2.1 Mm.Autoclavable, Con Tran De Luz Por Fibra Óptica Incorpora Código De Color: Rojo.	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	OBTURADOR	K. STORZ	
1	Vaina Para Cisto-Uretroscopios, 11 Fr., Con 1 Canal De Instrumen- Tos, Obturador 27032 Do Y 2 Conos Luer-Lock, Paso Libre Con 27032 F, 5 Fr., Paso Libre Con 27032 G, 3 Fr., Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Mecanismo De Deflexión Con Uña Albarran Para Instrumentos De 3 Fr., Para Emplear Con La Vaina Para Cisto-Uretroscopios 27032 N	K. STORZ	
1	VAINA CISTOSCOPI. PED. 11Fr.	K. STORZ	
1	Vaina De Metal Con Llave Luer- Lock, Inclusive Tubo De Entrada, 13 Fr. Y Obturador 27047 Co, Código De Color: Rojo	K. STORZ	

RESECTOR INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	PINZA	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo Corte Por Acción De Resorte La Anilla Del Pulgar Es Móvil. En Posición De Reposo El Electrodo Dentro De La Vaina.	K. STORZ	
1	Puente Telescópico De Exploración	K. STORZ	
1	Cable De Alta Frecuencia Con Enchufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	

RESECTOR INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	ELEMENTO DE TRABAJO	K. STORZ	
1	Cable De Alta Frecuencia Con Conector De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Puente Telescópico De Exploración	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	

RESECTOR UROLOGIA QUIROFANO URGENCIAS

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	Vaina Para Resectores Inclusive Tubo De Entrada Y Salida, 26 Fr., Con Extremo Oblicuo, Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Los Elementos De Trabajo 27040 C/E/En Y 27050 C/ D/E/En, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Obturador Deflectante Para Las Vainas Para Resectores 27040 Bo, 27141 Bo, 27040 Sd/SI, 24/26 Fr., 27050 SI Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo (También Para Emplear Con El Uretrotomo Óptico) Corte Por Acción De Resorte . La Anilla Para El Pulgar Es Móvil. En La Posición De Reposo, El Asa Estará Situada Dentro De La Vaina	K. STORZ	
1	ELEMENTO DE TRABAJO	K. STORZ	

RESECTOR MONOPOLAR I QUIROFANO 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	

1	Vaina Para Resectores Inclusive Tubo De Entrada Y Salida, 26 Fr., Con Extremo Oblicuo, Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Los Elementos De Trabajo 27040 C/E/En Y 27050 C/ D/E/En, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	Obturador Deflectante Para Las Vainas Para Resectores 27040 Bo, 27141 Bo, 27040 Sd/SI, 24/26 Fr.,27050 SI Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo (También Para Emplear Con El Uretrotomo Óptico) Corte Por Acción De Resorte . La Anilla Para El Pulgar Es Móvil. En La Posición De Reposo, El Asa Estará Situada Dentro De La Vaina	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo Para Usar Con Resectoscopio 24/26 Fr. 27040 Bo/ 27040 SI/27050 SI Y Sondas De Lás	K. STORZ	

RESECTOR MONOPOLAR III QUIROFANO 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	VIDEO URETERO	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	Vaina Para Resectores Inclusive Tubo De Entrada Y Salida, 26 Fr., Con Extremo Oblicuo, Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Los Elementos De Trabajo 27040 C/E/En Y 27050 C/ D/E/En, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	Obturador Deflectante Para Las Vainas Para Resectores 27040 Bo, 27141 Bo, 27040 Sd/SI, 24/26 Fr.,27050 SI Código De Color: Amarillo	K. STORZ	

RESECTOR QUIROFANO 1 URO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	Puente Telescópico De Exploración	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo Para Utilizar Resectoscopio 24/26 Fr. 27040 Bo/27141 Bo/27040 SI/27050 Y Sondas Intersticiales	K. STORZ	
1	Deflecting Obturator, for use with outer sheaths 26 Fr., 27040 SL / 27050 SL, Color code: yellow	K. STORZ	
1	Obturador Deflectante Para Las Vainas Para Resectores 27040 Bo, 27141 Bo, 27040 Sd/SI, 24/26 Fr.,27050 SI Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Guia Telescópica Según Fraundorfe Con Canal De 7 Fr. Para Utilizar 27040 SI Y 27050 SI	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo Para Usar Con Resectoscopio 24/26 Fr. 27040 Bo/ 27040 SI/27050 SI Y Sondas De Lás	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

RESECTOR BIPOLAR I Q 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	Working Element, bipolarMotion by means of a spring.The thumb support is movable.In rest position the electrode isinside the sheath.	K. STORZ	
1	Obturador Estándar Para Las Vainas Para Resectores 27040 Bo, 27141 Bo, 27040 Sd/SI, 27050 SI, 24/26 Fr., Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Vaina Para Resectores Inclusive Tubo De Entrada Y Salida, 26 Fr., Con Extremo Oblicuo, Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Los Elementos De Trabajo 27040 C/E/En Y 27050 C/ D/E/En, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	CABLE	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Dimensiones In 503 X 229 X 46 Mm Consistente En: 39301 Ha Parte Inferior 39301 Hb Tapadera 39301 He Alfombrilla De Silicona	K. STORZ	

RESECTOR BIPOLAR II Q 1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	OBTURADOR	K. STORZ	
1	Working Element, bipolarMotion by means of a spring.The thumb support is movable.In rest position the electrode isinside the sheath.	K. STORZ	
1	Vaina Para Resectores Inclusive Tubo De Entrada Y Salida, 26 Fr., Con Extremo Oblicuo, Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Los Elementos De Trabajo 27040 C/E/En Y 27050 C/ D/E/En, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Vaina Interior Con Aislamiento Cerámico, Para Emplear Con Las Vainas 27040 Sd/SI, 26 Fr.	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo (También Para Emplear Con El Uretrotomo Óptico) Corte Por Acción De Resorte . La Anilla Para El Pulgar Es Móvil. En La Posición De Reposo, El Asa Estará Situada Dentro De La Vaina	K. STORZ	
1	Bipolar cable for resectoscopy, lenght 3m, for 20535220 Autocon II 400 with Bi-MF socket	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Dimensiones In 503 X 229 X 46 Mm Consistente En: 39301 Ha Parte Inferior 39301 Hb Tapadera 39301 He Alfombra De Silicona	K. STORZ	

CISTOSCOPIO COMPACTO Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cisto-Uretroscopio Universal Con Hopkins De 30° Visión Foroblicua, Diámetro 17 Fr. Transmisión De Lu Óptica Incorporada. Canal De Inst	K. STORZ	
1	Cisto-Uretroscopio Universal Con Hopkins De 30° Visión Foroblicua, Diámetro 17 Fr. Transmisión De Lu Óptica Incorporada. Canal De Inst	K. STORZ	
1	Cisto-Uretroscopio Universal Con Hopkins De 30° Visión Foroblicua, Diámetro 17 Fr. Transmisión De Lu Óptica Incorporada. Canal De Inst	K. STORZ	

CAJA BLANCA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	Vaina Para Cisto-Uretroscopios, 20 Fr., Con Obturador 27026 Co Y 2 Conos Luer-Lock, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
2	Obturador Para Vaina 27026 U	K. STORZ	
2	Adaptador Con Macanismo De Defle- Xión, Uña De Albarran, Con Dos Canales Para Instrumentos, Con Muesca	K. STORZ	

MATERIAL SUELTO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CISTOURETROFIBROSCOPIO	K. STORZ	
1	CISTOURETROFIBROSCOPIO	K. STORZ	
2	Pinzas De Agarre Para Fragmentos Pequeños, Apertura Unilateral, Flexible, 5 Charr., Longitud 73 Cm	K. STORZ	
2	Pinzas Para Biopsia, Aperutra Unilateral, Flexible, 5 Charr., Longitud 73 Cm	K. STORZ	
1	Puente Telescópico De Exploración	K. STORZ	
1	Puente Telescópico De Exploración Con 2 Canales De Instrumentos	K. STORZ	
1	Obturador Para Vaina 27026 C	K. STORZ	
1	Vaina Para Cistoscopio- Uretroscopio, 17 Charr., Paso Para Catéter 5 Charr., Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Vaina Para Cistoscopio- Uretroscopio, 17 Charr., Paso Para Catéter 5 Charr., Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Obturador Para Vaina 27026 U	K. STORZ	
1	Pinzas Para Extracción De Cuerpos Extraños, Abertura Bilateral, Flexibles, 7 Fr., Longitud 40 Cm	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
2	Pinzas De Biopsia, Abertura Bi- Lateral, Flexibles, 7 Fr., Longi- Tud 40 Cm	K. STORZ	

URETROTOMO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Puente Telescópico De Exploración	K. STORZ	
1	Elemento De Trabajo (También Para Emplear Con El Uretrotomo Óptico) Corte Por Acción De Resorte . La Anilla Para El Pulgar Es Móvil. En La Posición De Reposo, El Asa Estará Situada Dentro De La Vaina	K. STORZ	
1	Vaina Sachse, Para Uretrotomos, 21 Fr, Con Canal Para Dilatador Variación Filiform Y 2 Conos Luer-Lock	K. STORZ	
1	Vaina Suplementaria, De Media Caña, Para Introducir Un Catéter De Balón, Aplicable A La Vaina Para Uretrótomos 27068 D	K. STORZ	

LITOTRIPTOR I

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Vaina Para Cisto-Uretroscopios, 25 Fr., Con Obturador 27026 Ao Y 2 Conos Luer-Lock, Código De Color: Blanco	K. STORZ	
1	Obturador Para Vaina 27026 A	K. STORZ	
1	Vaina Para Cisto-Uretroscopios, 22 Fr., Con Obturador 27026 Bo Y 2 Conos Luer-Lock, Código De Color: Azul	K. STORZ	
1	Pinzas De Biopsia Con Boca Especialmente Grande, Apertura Bilateral	K. STORZ	

NEFROSCOPIO I Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Adaptador	K. STORZ	
1	Telescopio Recto Gran Angular De 0° Hopkins, Dotado De Ocular Oblicuo, Con Canal De Instrumentos Y Con Transmisión De Luz Por Fibra Óptica Incorporada, Autoclava Código De Color: Negro	K. STORZ	
1	Vaina Quirúrgica, 17 Fr., Incluye Sive Tubo De Conexión Para Irrigación Y 2 Conos Luer-Lock	K. STORZ	
1	Obturador Hueco Y Dilatador Fascial	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Para Fragmentos D Grandes, 3 Mandíbulas Expansibles Púas Para Fijación, Con Mango De Código De Color: Rojo-Negro	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre Para Fragmentos D Grandes, Dentada, Mandíbulas De D Con Mango De Anillo, Long. 38 Cm Código De Color: Rojo-Negro	K. STORZ	
1	Obturador Y Dilatador Fascial Per Código De Color: Blanco-Rojo	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	

OPTICA SUELTAS URO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio Recto De Visión Amplificada De 0° Hopkins Ii, Diámetro 4 Mm, Esterilizable En Autoclave, Con Transmisión De Luz Por Fibra Óptica Incorporada, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio Recto De Visión Amplificada De 0° Hopkins Ii, Diámetro 4 Mm, Esterilizable En Autoclave, Con Transmisión De Luz Por Fibra Óptica Incorporada, Código De Color: Verde	K. STORZ	
1	Telescopio De 30° Hopkins II - Diám. 4mm. Autoclavable.	K. STORZ	
1	Telescopio De 70° Hopkins Ii De Visión Oblicua E Imagen Grande, Diámetro 4 Mm, Esterilizable En Autoclave, Con Conductor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Telescopio De 70° Hopkins Ii De Visión Oblicua E Imagen Grande, Diámetro 4 Mm, Esterilizable En Autoclave, Con Conductor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Telescopio De 70° Hopkins Ii De Visión Oblicua E Imagen Grande, Diámetro 4 Mm, Esterilizable En Autoclave, Con Conductor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Amarillo	K. STORZ	
1	Cisto-Uretroscopio Universal Con Hopkins De 30° Visión Foroblicua, Diámetro 17 Fr. Transmisión De Luz Óptica Incorporada. Canal De Inst	K. STORZ	

1	Cisto-Uretroscopio Universal Con Hopkins De 30° Visión Foroblicua, Diámetro 17 Fr. Transmisión De Lu Óptica Incorporada. Canal De Inst	K. STORZ	
1	Cisto-Uretroscopio Universal Con Hopkins De 30° Visión Foroblicua, Diámetro 17 Fr. Transmisión De Lu Óptica Incorporada. Canal De Inst	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 409 X 76 X 33 Mm. Consistente En: 39301 Ba Parte Inferior, Fondo 39301 Bb Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona 39301 Ch Soporte De Silicona Para Ópticas Cistoscopia 4 Mm Y 10 Mm	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 409 X 76 X 33 Mm. Consistente En: 39301 Ba Parte Inferior, Fondo 39301 Bb Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona 39301 Ch Soporte De Silicona Para Ópticas Cistoscopia 4 Mm Y 10 Mm	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 409 X 76 X 33 Mm. Consistente En: 39301 Ba Parte Inferior, Fondo 39301 Bb Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona 39301 Ch Soporte De Silicona Para Ópticas Cistoscopia 4 Mm Y 10 Mm	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 409 X 76 X 33 Mm. Consistente En: 39301 Ba Parte Inferior, Fondo 39301 Bb Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona 39301 Ch Soporte De Silicona Para Ópticas Cistoscopia 4 Mm Y 10 Mm	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 409 X 76 X 33 Mm. Consistente En: 39301 Ba Parte Inferior, Fondo 39301 Bb Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona 39301 Ch Soporte De Silicona Para Ópticas Cistoscopia 4 Mm Y 10 Mm	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 648 X 102 X 70 Mm Consistente En: 39301 Da Parte Inferior, Fondo, S 39301 Db Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona Para Para Ópticas Broncoscopia 5 Mm Y	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 648 X 102 X 70 Mm Consistente En: 39301 Da Parte Inferior, Fondo, S 39301 Db Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona Para Para Ópticas Broncoscopia 5 Mm Y	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 648 X 102 X 70 Mm Consistente En: 39301 Da Parte Inferior, Fondo, S 39301 Db Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona Para Para Ópticas Broncoscopia 5 Mm Y	K. STORZ	

URETERO-REMOSCOPIO I

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Ureterscope, 9.5 Fr., 6°, one-step, conical, 9.5-13.5 Fr., length 43 cm, autoclavable, with angled eyepiece, fiber optic light transmission incorporated, 2 lateral irrigation ports and 1 working channel 6 Fr. for instruments 5 Fr.	K. STORZ	
1	Instrument port, 2 channels, with sealing system and quick- release lock	K. STORZ	

URETERO-REMOSCOPIO II

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Ureterscope, 9.5 Fr., 6°, one-step, conical, 9.5-13.5 Fr., length 43 cm, autoclavable, with angled eyepiece, fiber optic light transmission incorporated, 2 lateral irrigation ports and 1 working channel 6 Fr. for instruments 5 Fr.	K. STORZ	
1	Instrument port, 2 channels, with sealing system and quick- release lock	K. STORZ	

URETERO-REMOSCOPIO FLEXIBLE Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
-----	-------------	-------	---------

1	Uretero-Fiberscope, FLEX-X,steerable,Instrument channel: 3.6 Fr.Direction of view: 0° Angle of view: 88°Working length: 68 cmO.D. shaft: 7.5 Fr.Following accessories areincluded:27677 A Case11025 E Pressure Compensation13242 XL Leakage Tester276451 A Cleaning Brush	K. STORZ	
---	---	----------	--

CISTOSCOPIO FLEXIBLE Q1

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CISTOURETROFIBROSCOPIO	K. STORZ	

VIDEO-CISTOSCOPIO FLEXIBLE

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	MONITOR	K. STORZ	
1	VIDEO CISTO FELXIBLE	K. STORZ	

HISTEROSCOPIOS

HISTEROSCOPIO CAJA EXPLORACION

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Vaina Para Exploración, Diámetro 3.7 Mm, Con 1 Adaptador De Cierre Luer	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	

HISTEROSCOPIO III

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio Hopkins Foroblícuo De De Diámetro, Long. 30 Cm, Autocla Transmisión De Luz Por Fibra Ópti Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Operating Sheath, with channel for semi-rigid 5 Fr. instruments, with one stopcock and one LUER- lock adaptor, for use with CF Operating Sheath 26153 BO and telescope 26120 BA or 26120 BHA	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Continuous-Flow operating sheath,with one stopcock and one LUER-lock adapter, for use with Operating Sheath 26153 BI	K. STORZ	
1	Pinza De Biopsia De Cucharilla, 5 Semirígida, Mandíbulas De Acción	K. STORZ	
1	Tijeras Con Puntas Romas, 5 Fr. 3 Mandíbulas De Acción Simple.	K. STORZ	

HISTEROSCOPIO III

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Óptica HOPKINS®II 30°, 2 mm, 26 cm	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Operating Sheath, with channel for semi-rigid 5 Fr. instruments, with one stopcock and one LUER- lock adaptor, for use with CF-Operating Sheath 26152 BO and telescope 26008 BA	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Continuous-Flow operating sheath,with one stopcock and one LUER-lock adapter, for use with Operating Sheath 26152 BI	K. STORZ	

HISTEROSCOPIO I CONSULTAS EXTERNAS MAT.

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Óptica HOPKINS®II 30°, 2 mm, 26 cm	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Operating Sheath, with channel for semi-rigid 5 Fr. instruments, with one stopcock and one LUER- lock adaptor, for use with CF-Operating Sheath 26152 BO and telescope 26008 BA	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Continuous-Flow operating sheath,with one stopcock and one LUER-lock adapter, for use with Operating Sheath 26152 BI	K. STORZ	

HISTEROSCOPIO II CONSULTAS EXTERNAS MAT.

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
-----	-------------	-------	---------

1	BETTOCCHI Continuous-Flow operating sheath,with one stopcock and one LUER-lock adapter, for use with Operating Sheath 26152 BI	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Operating Sheath, with channel for semi-rigid 5 Fr. instruments, with one stopcock and one LUER- lock adaptor, for use with CF-Operating Sheath 26152 BO and telescope 26008 BA	K. STORZ	
1	Óptica HOPKINS®II 30°, 2 mm, 26 cm	K. STORZ	

HISTEROSCOPIO V CONSULTAS EXTERNAS MAT.

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Telescopio Hopkins Foroblícuo De De Diámetro, Long. 30 Cm, Autocla Transmisión De Luz Por Fibra Ópti Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Operating Sheath, with channel for semi-rigid 5 Fr. instruments, with one stopcock and one LUER- lock adaptor, for use with CF Operating Sheath 26153 BO and telescope 26120 BA or 26120 BHA	K. STORZ	
1	BETTOCCHI Continuous-Flow operating sheath,with one stopcock and one LUER-lock adapter, for use with Operating Sheath 26153 BI	K. STORZ	
1	Tijeras Con Puntas Romas, 5 Fr. 3 Mandíbulas De Acción Simple.	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre, Ambas Ramas Móviles, 7 Charr., Longitud 40 Cm	K. STORZ	

NEURO

NEUROCIRUGIA Q12

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Para In- Strumentos Bipolares Karl Storz Para Uso Con Coagulador Karl Storz 26020 Xa/Xb, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Aguja De Inyección, Flexible, Diá Long. 45 Cm, Desechable.	K. STORZ	
1	Ventriculostomy Forceps, diameter 1.7 mm, working length 30 cm	K. STORZ	
1	Cánula De Inyección	K. STORZ	
1	Pinzas Para Biopsia, Una Mordaza Móvil, Diámetro Exterior 2.7 Mm, Longitud Útil 28 Cm	K. STORZ	
1	CANULA	K. STORZ	
1	OPTICA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	Vaina Para Exploración, Diámetro 3.7 Mm, Con 1 Adaptador De Cierre Luer	K. STORZ	
1	Electrodo De Coagulación, Bipolar	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	

CAJA VENTRICULOSCOPIO INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Con En- Chufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	PINZAS ACODADAS	K. STORZ	
1	PINZAS ACODADAS	K. STORZ	
1	Electrodo De Coagulación, Bipolar	K. STORZ	
1	PINZAS ACODADAS	K. STORZ	
1	HOPKINS II Forward Oblique- Telescope 0°, enlarged view, diameter 2 mm, length 26 cm, autoclavable, fiber optic light transmission incorporated, color code: green	K. STORZ	
1	Handle, for operating sheath 28161 SS	K. STORZ	
1	Operating Sheath, graduated, size 2.6 mm x 4.0 mm, working length 15 cm, with three working channels for irrigation/suction and for instruments size 1.3 mm, for use with telescope 28008 AA/FA	K. STORZ	
1	Plastic Container for Sterilizing and Storage of variable instrument sets, perforated, with transparent lid, with silicone mat, double-level storage (1 additional insert), internal dimensions (w x d x h): 525 mm x 240 mm x 100 mm	K. STORZ	

1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio Diámetro 4.8 Mm, Longitud 250 Cm	K. STORZ	
---	--	----------	--

QUIROFANOS NEURO INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Con En- Chufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	GENITORI Pediatric Neuroendoscope, 30°, autoclavable, with mandrin, 3.2mm, graduated, fiber optic light transmission incorporated, working channel 1mm, 2 LUER-Lock cones, colour code: red	K. STORZ	
1	Mandrin in use with the GENITORI Neuroendoscope 28030GPA	K. STORZ	
1	Electrodo De Coagulación, Bipolar	K. STORZ	
1	Aguja De Inyección, Flexible, Diá Long. 45 Cm, Desechable.	K. STORZ	
1	Catéter De Succión, Flexible, Diá Long. 45 Cm, Desechable.	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Mandíbulas De Do Flexible, 1.0 Mm, Long. 30 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas para ventriculostomía, 1 mm	K. STORZ	
1	Plastic Container for Sterilizing and Storage of variable instrument sets, perforated, with transparent lid, with silicone mat, double-level storage (1 additional insert), internal dimensions (w x d x h): 525 mm x 240 mm x 100 mm	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	

CAJA HIPOFISIS - NEURO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	SEPARADOR CRANEAL	K. STORZ	
1	PINZA DE AGARRE	K. STORZ	
1	Pinzas De Biopsia, 5 Mm, Redondas En Forma De Cucharilla	K. STORZ	
1	PINZA DE AGARRE	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA BIOPSIA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	de DIVITIIS-CAPPABIANCA Curette, blunt, ID 3 mm, distally curved shaft, with round handle, length 25 cm	K. STORZ	
1	de DIVITIIS-CAPPABIANCA Curette, blunt, ID 3 mm, distally curved shaft, with round handle, length 25 cm	K. STORZ	
1	Click Line Outer Tube with Insert Curette, round, bendable, up to 90°, size 4.8 mm, working length 20 cm, with LUERlock adaptor for cleaning	K. STORZ	
1	Click Line Outer Tube with Insert Curette, round, bendable, up to 90°, size 4.8 mm, working length 20 cm, with LUERlock adaptor for cleaning	K. STORZ	
1	ANTRUM PUNCH - 360°	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Sacabocados Según Stammberger Corte Circular, Para Esfenodias Y Long. 18 Cm, Diámetro 3.5 Mm	K. STORZ	
1	Cuchillete Redondeado, Corte Vert	K. STORZ	
1	KERRISON Punch, downbiting 40° forward, size 3 mm, working length 18 cm	K. STORZ	
1	FRANK-PASQUINI Suction Tube, angular, O.D. 2.4 mm, tip curved upwards, ball end, with grip plate and cut-off hole, LUER, working length 13 cm	K. STORZ	
1	FRANK-PASQUINI Suction Tube, angular, O.D. 2.4 mm, tip curved downwards ball end, with grip plate and cut-off hole, LUER, working length 13 cm	K. STORZ	
1	FRANK-PASQUINI Suction Tube, angular, O.D. 3 mm, tip curved upwards, ball end, with grip plate and cut-off hole, LUER, working length 13 cm	K. STORZ	
1	FRANK-PASQUINI Suction Tube, angular, O.D. 3 mm, tip curved downwards ball end, with grip plate and cut-off hole, LUER, working length 13 cm	K. STORZ	

BRONCOSCOPIO

CAJA BRONCOSCOPIO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	DEFLECTOR PRISMATICO DE LUZ	K. STORZ	
1	Telescopio De 0° Hopkins De Visión Rectilínea, Diámetro 2.9 Mm, Longitud 36 Cm, Con Conductor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Long. De Trabajo 36 Autoclavable. Código De Color: Ve	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
1	Adaptador Fluvog Con Ventanilla Para Observación, Tapón Obturador Con Junta De Goma Y Ventanilla Con Escotadura	K. STORZ	
1	Adaptador Fluvog Con Ventanilla Para Observación, Tapón Obturador Con Junta De Goma Y Ventanilla Con Escotadura	K. STORZ	
2	VAINA	K. STORZ	
1	VAINA	K. STORZ	
2	VAINA	K. STORZ	
1	Broncoscopio Según Doesel-Huzly Longitud 26 Cm, Tamaño 3.5	K. STORZ	
1	Pinzas Para Esofagoscopios Y Broncoscopios, Boca Tipo Cocodrilo, Ambas Mandíbulas Móviles, Calibre De La Vaina 1.5 Mm, Longitud Útil 25 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Para Esofagoscopios Y Broncoscopios, Boca Tipo Cocodrilo, Ambas Mandíbulas Móviles, Calibre De La Vaina 1.5 Mm, Longitud Útil 35 Cm	K. STORZ	
1	Optical Coin Forceps for Pediatric Broncho-Esofagoscopes, 2 x 2 teeth, for use with telescope 10324 AA, forced controlled handle for removal of coins and flat foreign bodies	K. STORZ	
1	Optical Alligator Forceps for Pediatric Broncho-Esofagoscopes, for use with telescope 10324 AA, forced controlled handle for removal of hard foreign bodies	K. STORZ	
1	Optical Forceps for Pediatric Broncho-Esofagoscopes, with KILLIAN bean jaws, for use with telescope 10324 AA, forced controlled handle for removal of peanuts and soft foreign bodies	K. STORZ	
2	PINZA	K. STORZ	
1	DEFLECTOR	K. STORZ	

ORL

ORL QUIROFANO 8

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	FOTOFORO	K. STORZ	
1	FOTOFORO BINOCULAR	K. STORZ	
1	RINO-LARINGOFIBROSCOPIO 23x5,2	K. STORZ	110000074
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	

OPTICAS CENS Q8

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	OPTICA HOPKINS 0° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS 0° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS 0° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS 30° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS II - 30° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS II - 30° - 4mm.	K. STORZ	

1	OPTICA HOPKINS II - 70° - 4mm.	K. STORZ	
1	HOPKINS II Forward-Oblique	K. STORZ	

MATERIAL SUELTO Q8 CENS

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Tijeras Nasaes Rhinoforce, Lon- Gitud Útil 13 Cm, Rectas	K. STORZ	
1	Concotómo Rhinoforce Según Struycken, Longitud Útil 12 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 1	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 2	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 2	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 3	K. STORZ	
1	Troquel De Antro Rhinoforce Según Stammberger, Longitud Útil 10 Cm, Con Corte Hacia Arriba Y Hacia Atrás	K. STORZ	
1	Troquel De Antro Rhinoforce Según Stammberger, Longitud Útil 10 Cm, Con Corte Hacia La Izquierda Y Hacia Atrás	K. STORZ	

CENS I

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	Tijeras Nasaes Rhinoforce, Lon- Gitud Útil 13 Cm, Rectas	K. STORZ	
1	Tijeras Nasaes Rhinoforce, Lon- Gitud Útil 13 Cm, Rectas	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 1	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 3	K. STORZ	
1	ANTRUM PUNCH - 360°	K. STORZ	
1	Tubito De Irrigación Según V.Eicken, Curvatura Larga, Cierre Luer, Longitud 12.5 Cm, Diámetro Exterior 3.0 Mm, Cierre Luer	K. STORZ	
1	Tubito De Irrigación Según V.Eicken, Longitud 12.5 Cm, Curvatura Corta, Diámetro Exte- Rior 4.0 Mm, Cierre Luer	K. STORZ	
1	Bisturí Falciforme, Longitud 19 Cm, En Punta	K. STORZ	
1	Cucharilla De Seno Frontal Según Kuhn-Bolger, Ovalada, Corte Hacia Adelante, Curvada 55°	K. STORZ	
1	Pinzas Con Doble Cucharilla, Abertura Vertical, Curvadas Hacia Atrás 110°, Longitud Útil 12 Cm, Cucharilla 4 Mm Diámetro	K. STORZ	
1	Pinzas Con Doble Cucharilla, Abertura Horizontal, Curvadas Hacia Atrás 110°, Longitud Útil 12 Cm, Cucharilla 4 Mm Diámetro	K. STORZ	
1	Pinzas Rhinoforce Con Cucharilla Doble Según Stammberger, Abertura Horizontal, Curvada Hacia Arriba 65°, Longitud Útil 12 Cm, Cucha- Rilla 3 Mm Diámetro	K. STORZ	

CENS II

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	Pinzas Nasaes Según Grünwald, En Forma De Bayoneta, 20 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Nasaes Rhinoforce, Lon- Gitud Útil 13 Cm, Rectas	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Rhinoforce Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 12 Cm, Tamaño 1	K. STORZ	
1	Pinzas Nasaes Según Blakesley, Rectas, Longitud Útil 11 Cm, Tamaño 3	K. STORZ	
1	Troquel De Antro Rhinoforce Según Stammberger, Longitud Útil 10 Cm, Con Corte Hacia Arriba Y Hacia Atrás	K. STORZ	
1	Tubito De Irrigación Según V.Eicken, Curvatura Larga, Cierre Luer, Longitud 12.5 Cm, Diámetro Exterior 2.5 Mm	K. STORZ	
1	Tubito De Irrigación Según V.Eicken, Longitud 12.5 Cm, Curvatura Corta, Diámetro Exte- Rior 3 Mm, Cierre Luer	K. STORZ	
1	Bisturí Falciforme, Longitud 19 Cm, En Punta	K. STORZ	
1	Bisturí Falciforme, Longitud 19 Cm, En Punta	K. STORZ	
1	Cucharilla De Seno Frontal Según Kuhn-Bolger, Ovalada, Corta Hacia Adelante, Curvada 90°	K. STORZ	
1	Troquel Óseo Según Hajek-Kofler, Corte Sucesivo, Giratorio, Tamaño 3.2 Mm X 4 Mm, Longitud Útil 17 Cm	K. STORZ	
1	Troquel Óseo Según Hajek-Kofler, Fijo, Con Corte Hacia Abajo Y Hacia Atrás, Tamaño 3.5 Mm X 3.7 Mm, Longitud Útil 14 Cm	K. STORZ	

1	Pinzas Con Doble Cucharilla, Abertura Vertical, Curvadas Hacia Arriba 70°, Longitud Útil 12 Cm, Cucharilla 4 Mm Diámetro	K. STORZ	
1	Pinzas Con Doble Cucharilla, Abertura Horizontal, Curvadas Hacia Arriba 70°, Longitud Útil 12 Cm, Cucharilla 4 Mm Diámetro	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Heuwieser, Rama Fija, Curvadas 90°, Rama Móvil Hasta 120° Con Abertura Hacia Atrás, Longitud Útil 10 Cm	K. STORZ	
1	SEPARADOR		
1	Pinza blakesley - recta	K. STORZ	
1	Tijeras Nasales Rhinoforce, Lon- Gitud Útil 13 Cm, Rectas	K. STORZ	

LARINGO INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pinza Luminosa Según Benjamin- Havas, Corta, Para Iluminación P	K. STORZ	
1	SOPORTE	K. STORZ	
1	SOPORTE	K. STORZ	
1	SOPORTE	K. STORZ	
2	Laringoscopio Según Parsons, Para Niños Pequeños, Longitud 11 Cm	K. STORZ	
1	Laringoscopio Según Parsons, Para Niños Recién Nacidos, Longitud 9 Cm	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Expansible Según Weerda, Longitud 13.5 Cm, Para Niños	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 18 Cm, Tamañ Pequeño (Para Condiciones Anatómicas De Particular Difi- Cultad)	K. STORZ	
1	SOPORTE	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 15 Cm, Para Niños	K. STORZ	

CONSULTA ORL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	VIDEO NASO	K. STORZ	
1	MONITOR	K. STORZ	

FONOCIRUGIA Q 8

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Cable De Alta Frecuencia Con En- Chufe De 4 Mm Para Aparatos De Diseño Antiguo, Longitud 300 Cm	K. STORZ	
1	Pinza Luminosa Según Benjamin- Havas, Corta, Para Iluminación P	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tenacillas Miniatura De Agarre Según Kleinsasser, Estriadas, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tenacillas Miniatura De Agarre Según Kleinsasser, Estriadas, Curvadas Hacia La Derecha, Lon- Gitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tenacillas Miniatura De Agarre Según Kleinsasser, Estriadas, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Sin Bloqueo, Estriadas, Rectas, Con Boca Triangular, Curvadas Hacia Arriba Y Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangularfenestrated jaws, very delicate, curved upwards right, fine sheathconical reinforced from distal toproximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Estriadas, Rectas, Con Boca Triangular, Curvadas Hacia Arriba Y Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangularfenestrated jaws, very delicate, curved upwards left, fine sheathconical reinforced from distalto proximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	

1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tubo De Succión Según Klein- Sasser, 2 Mm De Diámetro Exterior	K. STORZ	
1	Tubo De Succión Según Klein- Sasser, 3 Mm De Diámetro Exte- Rior, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	

CAJA LARINGO I

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pinza Luminosa Según Benjamin- Havas, Corta, Para Iluminación P	K. STORZ	
1	SOPORTE	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 18 Cm, Para Adultos, Tamaño Grande	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 18 Cm, Tamaño Mediano (Modelo Muy Utilizado)	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 18 Cm, Tamaño Pequeño (Para Condiciones Anatómicas De Particular Difi- Cultad)	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 15 Cm, Para Niños	K. STORZ	

CAJA LARINGO I LASER

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pinza Luminosa Según Benjamin- Havas, Corta, Para Iluminación P	K. STORZ	
1	SOPORTE	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Expansible Según Weerda, Longitud 18 Cm, Para Adultos	K. STORZ	
1	LARINGO	K. STORZ	
1	LARINGO	K. STORZ	

CAJA LARINGO II LASER

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	SOPORTE	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 18 Cm, Para Adultos, Tamaño Grande	K. STORZ	
1	Laringoscopio Quirúrgico Según Kleinsasser, Longitud 18 Cm, Tamaño Mediano (Modelo Muy Utilizado)	K. STORZ	
1	Laringoscopio Operativo Extensibl Con Acabado Mate Especia Tratamiento De Laser, Con Canal D De Humos Integrado, Para Utilizar Clip De Iluminación Proximal 497 Longitud 18 Cm. Tamaño Adulto Con Introducción Y Niños. Diámetro Proximal 23 Mm X 15 Mm	K. STORZ	

CAJA PINZAS MICRO LARINGE I

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Sin Bloqueo, Estriadas, Rectas, Con Boca Triangular, Curvadas Hacia Arriba Y Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangularfenestrated jaws, very delicate, curved upwards right, fine sheathconical reinforced from distal toproximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Estriadas, Rectas, Con Boca Triangular, Curvadas Hacia Arriba Y Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangularfenestrated jaws, very delicate, curved upwards left, fine sheathconical reinforced from distalto proximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
2	Tubo De Succión Según Klein- Sasser, 2 Mm De Diámetro Exterior	K. STORZ	

1	Tubo De Succión Según Klein- Sasser, 3 Mm De Diámetro Exte- Rior, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
---	---	----------	--

CAJA PINZAS MICRO LARINGE II LASER

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pinzas De Biopsia, 5 Mm, Redondas En Forma De Cucharilla	K. STORZ	
1	TUBO COAGULACION	K. STORZ	
1	TUBO COAGULACION	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangularfenestrated jaws, very delicate, curved upwards right, fine sheathconical reinforced from distal to proximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Estriadas, Rectas, Con Boca Triangular, Curvadas Hacia Arriba Y Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangularfenestrated jaws, very delicate, curved upwards left, fine sheathconical reinforced from distal to proximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Bisturí Según Kleinsasser, En Forma De Hoz, Angulado, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Bisturí Según Kleinsasser, En Forma De Hoz, Corte Recto, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Bisturí Según Kleinsasser, Forma Bastón De Golf, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Protector Para La Protección Del Tejido Contra Irradiaciones Fortuitas Con El Rayo Laser, Con Canal De Succión Para Los Vapores De Laser, Longitud Útil 23 Cm, Curvado, Redondo, Diámetro 5 Mm	K. STORZ	
1	Protector Para Resguardar El Tejido Contra Irradiación Involuntaria Con Laser, Especialmente Mateado, Con Canal De Aspiración Para Vapores De Laser, Longitud Útil 23 Cm, Acodado Hacia Arriba, Ovalado, Diámetro 7 Mm	K. STORZ	
1	Empuñadura Según Kleinsasser, Para 8595 A-8596 T, 8693 A/B	K. STORZ	
2	Tubo De Succión Según Klein- Sasser, 2.5 Mm De Diámetro Exte- Rior, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Cánula Aislada Según Steiner Para Coagulación, Con Mango Ergonómico Para Coagulación Monopolar, Con E Limpieza 8606 Fm, Long. 23 Cm, Di	K. STORZ	
1	Cánula Aislada Según Steiner Para Coagulación, Con Mango Ergonómico Para Coagulación Monopolar, Con E Limpieza 8606 Fm, Long. 23 Cm, Di	K. STORZ	
1	Cánula Aislada Según Steiner Para Coagulación, Con Mango Ergonómico Para Coagulación Monopolar, Con E Limpieza 8606 Fm, Long. 23 Cm, Di	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Dentada, Acabado Long. 22 Cm, Delicada.	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Cocodrilo, Con D Acabado Mate Especial, Long. 22 C Con Canal De Succión De Humos Int	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Dentada, Con Die Fenestrada, Acabado Mate Especial Tamaño Extra Delicada, Curva Arri	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Dentada, Vaina A Long. 23 Cm, Curva Derecha	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Dentada, Vaina A Long. 23 Cm, Curva Izquierda	K. STORZ	

CAJA MATERIAL MICROLARINGE (MAT. NUEVO)

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
3	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 230 Cm	K. STORZ	
1	Tubo De Aspiración De Humos Para Tratamiento Laser Con Laringosco- Pios 8588 A-B	K. STORZ	
1	Portaluz De Fibra Óptica Para Laringoscopios 8590 B-JI	K. STORZ	
1	Portaluz De Fibra Óptica Para Laringoscopios 8590 B-JI	K. STORZ	
1	Portaluz De Fibra Óptica Para Laringoscopios 8590 K-L	K. STORZ	

1	Portaluz De Fibra Óptica Para Laringoscopios 8590 K-L	K. STORZ	
1	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
2	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
2	Pinzas Según Kleinsasser Con Mandíbulas En Cucharilla, 2.0 Mm, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
2	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Sin Bloqueo, Estriadas, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Según Klein- Sasser, Sin Bloqueo, Estriadas, Rectas, Con Boca Triangular, Curvadas Hacia Arriba Y Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Miniature Forceps, for endo-laryngeal micro surgery, serrated, with triangular fenestrated jaws, very delicate, curved upwards left, fine sheath conical reinforced from distal to proximal, working length 23 cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
2	Tijeras Según Kleinsasser, Rectas, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Derecha, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tijeras Según Kleinsasser, Curvadas Hacia La Izquierda, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Tubo De Succión Según Klein- Sasser, 2.5 Mm De Diámetro Exterior, Longitud Útil 23 Cm	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Cocodrilo, Con D Acabado Mate Especial, Long. 22 C	K. STORZ	
1	Pinza De Agarre, Cocodrilo, Con D Acabado Mate Especial, Long. 22 C Con Canal De Succión De Humos Int	K. STORZ	

SOPORTE PECTORAL LARINGE

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Holding rod for support table, GOETTINGEN model 8575, autoclavable, for high adjustment	K. STORZ	
1	Clamp for support table GOETTINGEN model 8575 L, autoclavable, attachable to the operating table's sliding rails 25 mm x 10 mm	K. STORZ	
1	Swivelling arm for support table GOETTINGEN model 8575 L, with movable plate, autoclavable	K. STORZ	

TRAUMA

QUIROFANO DIA - ARTROSCOPIO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	AGUJA	K. STORZ	
1	Telescopio Miniatura Recto De 0º 1 Mm De Diámetro, Long. 6 Cm. Tra Luz Por Fibra Óptica Incorporado.	K. STORZ	
1	TELEPACK	K. STORZ	
1	Cabeza De Cámara Telecam, Sistema Color Pal, Con Zoom Parafocal Int F=25-50 Mm	K. STORZ	
1	OBTURADOR	K. STORZ	
1	Pinzas Pequeñas Para El Oído Según Wullstein, Sumamente Finas, Cuchara Ovalada, Longitud Útil 8 Cm, 0.9 Mm	K. STORZ	
1	Obturador Romo Para Vainas 28126 Código De Color: Verde-Rojo-Amari	K. STORZ	
1	Vaina Para Artroscopio, Diámetro 5.5 Mm, Longitud 12 Cm, Provista De Dos Llaves, Giratorias, Para Utilizar Con Los Telescopios Hopkins De 0º, 30º, 70º Y 90º, Código De Color: Verde-Rojo- Amarillo	K. STORZ	
1	Pinzas Universales Arthroforce Iii Take-Apart Según Blakesley, Diámetro 2.8 Mm, Longitud Útil 13 Cm, Que Consta De: 28169 A Mango Sin Enclavamiento 28067 A Suplemento De Pinzas	K. STORZ	
1	Troquel Arthroforce Iii Take-Apart, Corte Completo, Recto, Diámetro 2.8 Mm, Longitud Útil 13 Cm, Que Consta De: 28169 A Mango Sin Enclavamiento 28067 B Suplemento De Pinzas	K. STORZ	
1	Sacabocados Arthroforce Iii Take- Angulado 15º Hacia Arriba, 2.3 Mm Consistente En: 28083 Mb Terminal De Trabajo 28169 A Mango Sin Retención	K. STORZ	
1	Telescopio Hopkins 30º, Visión Frontal, Gran Angular, Diámetro 2.4 Mm, Longitud 10 Cm, Esterilizado En Autoclave, Con Conductor De Luz De Fibra De Vidrio Incorporado, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Gancho De Palpación, Longitud Útil 7.5 Cm, Longitud Del Gancho 1 Mm, Diámetro 1.5 Mm	K. STORZ	

1	Vaina Para Artroscopio High-Flow, Diámetro 3.2 Mm, Longitud De Trabajo 8.5 Cm, Para Utilizar Con El Telescopio 28300 Ba De 30 Grados, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Vaina Para Artroscopio High-Flow, Diámetro 3.2 Mm, Longitud De Trabajo 8.5 Cm, Para Utilizar Con El Telescopio 28300 Ba De 30 Grados, Código De Color: Rojo	K. STORZ	
1	Contenedor De Plástico Perforado Esterilización Y Almacenaje, Perf Tapa Transparente, Con Soporte Pa De Silicona, Dimensiones Interior 282 X 76 X 33 Mm Consistente En: 39301 Aa Parte Inferior, Fondo, S 39301 Ab Tapadera, Sólo 39301 Ah Soporte De Silicona Para Para Ópticas Artroscopia 4 Mm Y S	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS II - 30° - 4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS II - 70° - 4mm.	K. STORZ	

QUIROFANO DIA - HOMBRO

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Obturador Afilado Para Vainas 281 Código De Color: Verde-Rojo-Amari	K. STORZ	
1	Obturador Romo Para Vainas 28126 Código De Color: Verde-Rojo-Amari	K. STORZ	
1	Vaina Para Artroscopio, Diámetro 5.5 Mm, Longitud 12 Cm, Provista De Dos Llaves, Giratorias, Para Utilizar Con Los Telescopios Hopkins De 0°, 30°, 70° Y 90°, Código De Color: Verde-Rojo- Amarillo	K. STORZ	
1	Sonda Con Gancho Y Retractor, Graduada, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 8.5 Cm, Longitud Del Gancho 2 Mm	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Cable De Luz De Fibra De Vidrio, Diámetro 3.5 Mm, Longitud 180 Cm	K. STORZ	
1	OPTICA	K. STORZ	

QUIROFANO DIA - RODILLA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Obturador Romo Para Vainas 28126 Código De Color: Verde-Rojo-Amari	K. STORZ	
1	Vaina Para Artroscopio, Diámetro 5.5 Mm, Longitud 12 Cm, Provista De Dos Llaves, Giratorias, Para Utilizar Con Los Telescopios Hopkins De 0°, 30°, 70° Y 90°, Código De Color: Verde-Rojo- Amarillo	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	Pinzas De Agarre Artroforce Iii Take-Apart, Con Diente De Ratón, Sin Dispositivo De Trinquete, Diámetro 3.5 Mm, Longitud Útil 13 Cm, Que Consta De: 28169 A Mango Sin Enclavamiento 28069 L Suplemento De Pinzas	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA	K. STORZ	
1	PINZA BASKET SILCUT RECTA, 3.4mm.	K. STORZ	
1	PINZA BASKET SILCUT 15° - 3.4mm.	K. STORZ	
1	PINZA BASKET SILCUT 30º IZDA. - 3.4mm.	K. STORZ	
1	PINZA BASKET SILCUT 30º DCHA. - 3.4mm.	K. STORZ	
1	PINZA BASKET SILCUT 90º DCHA. - 3,4mm.	K. STORZ	
1	OPTICA HOPKINS II - 30° - 4mm	K. STORZ	
1	GANCHO	K. STORZ	

TORRE ENDOSCÓPICA QX7- HD

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CABEZAL DE CÁMARA FULL HD, mod. IMAGE1 S H3-Z	K. STORZ	
1	UNIDAD DE CÁMARA IMAGE1 S CONNECT	K. STORZ	
1	MODULO ENLACE CÁMARA IMAGE1 S H3-LINK	K. STORZ	
	TORRE ENDOSCÓPICA NEUROCIGÍA - HD		
QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	FUENTE DE LUZ LED 175 W.	K. STORZ	

1	MONITOR LCD 27"	K. STORZ	
1	UNIDAD DE CÁMARA IMAGE1 S CONNECT	K. STORZ	
1	MODULO ENLACE CÁMARA IMAGE1 S H3-LINK	K. STORZ	
1	CABEZAL DE CÁMARA FULL HD, mod. IMAGE1 S H3-Z	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto - LP140	K. STORZ	
1	Soporte para Monitor plano LP120	K. STORZ	

TORRE ENDOSCÓPICA - QX8 ORL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	MONITOR LCD 26"	K. STORZ	
1	UNIDAD DE CÁMARA IMAGE1 S CONNECT	K. STORZ	
1	MODULO ENLACE CÁMARA IMAGE1 S H3-LINK	K. STORZ	
1	CABEZAL DE CÁMARA FULL HD, mod. IMAGE1 S H3-Z	K. STORZ	
1	Carro Transporte Abierto - LP140	K. STORZ	
1	Soporte para Monitor plano LP120	K. STORZ	

VIDEO-NASOLARINGOSCOPIO FLEXIBLE (DISFAGIA INFANTIL)

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	VIDEO-NASOLARINGOSCOPIO FLEXIBLE, DIÁMETRO 2.9 MM.	K. STORZ	
1	PANTALLA MONITOR P/VIDEO-NASOLARINGOSCOPIO	K. STORZ	

FIBRO-URETERORRENOSCOPIO - QX1 UROLOGÍA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	FIBRO-URETERORRENOSCOPIO 7.5 CH., mod. FLEX-X2	K. STORZ	

ACTUALIZACIÓN QUIROFANO 5 - INTEGRADO (MATERNAL)

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	ESCALADOR VIDEO OR1 3G Multiformato	K. STORZ	
1	CABEZAL DE CÁMARA FULL HD, mod. IMAGE1 S H3-Z	K. STORZ	
1	UNIDAD DE CÁMARA IMAGE1 S CONNECT	K. STORZ	
1	MODULO ENLACE CÁMARA IMAGE1 S H3-LINK	K. STORZ	
1	MONITOR LCD 32" G2	K. STORZ	
1	MONITOR LCD 26" GB HB conexión fibra 90R0053	K. STORZ	
1	Porta-Monitor Riel Frontal (G25758)	K. STORZ	

MANIPULADOR UTERINO - GINECOLOGÍA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	MANIPULADOR UTERINO CLERMONT-FERRAND	K. STORZ	

CISTOSCOPIO COMPACTO - UROLOGÍA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CISTOSCOPIO COMPACTO 17 CH., VISIÓN 30º	K. STORZ	

CAJA DE INSTRUMENTOS NAALES - QX8 ORL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	Tijeras finas puntiagudos 10,5 cm.	K. STORZ	
2	Pinzas auriculares FISCH	K. STORZ	
2	Pinzas pequeñas para oído	K. STORZ	
2	Pinzas sacabocados cabeza martillo 8 cm.	K. STORZ	
2	Microtijeras extra-delicada 3mm., long. 8 cm.	K. STORZ	
2	Tijeras BELLUCI, long. 8 cm., curva derecha	K. STORZ	
2	Tijeras BELLUCI, long. 8 cm., curva izquierda	K. STORZ	
2	Tijeras nasales FISCH-BELLUCI, lamina 7 mm.	K. STORZ	
2	Pinzas auriculares de FISCH, 8 cm.	K. STORZ	
1	Perforador de FISCH, 0.3 mm., long. 16 cm.	K. STORZ	

1	Perforador de FISCH, 0.4 mm., long. 16 cm.	K. STORZ	
1	Perforador de FISCH, 0.5 mm., long. 16 cm.	K. STORZ	
1	Perforador de FISCH, 0.6 mm., long. 16 cm.	K. STORZ	
1	Bisturí circular con aspiración, giratorio	K. STORZ	
1	Tubo de aspiración curvado 8 mm.	K. STORZ	
1	Tubo de aspiración curvado 8 mm.	K. STORZ	
1	Tubo de aspiración curvado 6 mm.	K. STORZ	
1	Legra doble, long. 17 cm.	K. STORZ	
1	Disector de THOMASSIN, long. 18 cm.	K. STORZ	
1	Óptica nasal 4.0 mm., visión 0°, long. 14 cm.	K. STORZ	
1	Óptica nasal 4.0 mm., visión 45°, long. 14 cm.	K. STORZ	

CAJA DE INSTRUMENTOS LAPAROSCOPIA - GINECOLÓGICA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Anudador extracorpóreo según CLERMON-FERRAND	K. STORZ	
1	Instrumento de sutura extracorpórea, 2.8 mm.	K. STORZ	
1	Pinzas de agarre dentada, click-line, nodulos linfáticos	K. STORZ	
1	Cánula de punción diámetro 1.6 mm., long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Cánula de punción diámetro 1.6 mm., long. 36 cm.	K. STORZ	

CAJA DE INSTRUMENTOS NAALES - QX8 ORL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Elevador don aspiración FREER, long. 19 cm.	K. STORZ	
1	Tubo de aspiración FRANK-PASQUINI, 2.4 mm.	K. STORZ	
1	Instrumento doble curvado, CALTELNUOVO, long.22 cm.	K. STORZ	
1	Pinzas nasales corte arriba 65° izquierda, RHINOFORCE	K. STORZ	
1	Pinzas nasales BLAKESKEY corte arriba 45°, diámetro 3 mm.	K. STORZ	
1	Pinzas nasales BLAKESKEY corte arriba 45°, diámetro 2.5 mm.	K. STORZ	
1	Vaina irrigación y aspiración 0°, long. 14 cm.	K. STORZ	

CAJA DE INSTRUMENTOS CIRUGIA LAPAROSCÓPICA (CIRUGÍA GENERAL)

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	Retractor para Banda gástrica ajustable, diámetro 10 mm.	K. STORZ	
2	Óptica laparoscopia diámetro 10 mm., visión 0°	K. STORZ	
2	Tubo aspirador/irrigador de laparoscopia, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Tubo aspirador/irrigador de laparoscopia, long. 43 cm.	K. STORZ	
4	Pinza de agarre y disección curva, click-line, rotatoria, 36 cm. con bloqueo.	K. STORZ	
2	Pinza de punto boca delfín, click-line, rotatoria, 36 cm.	K. STORZ	
2	Pinza de agarre y disección curva, click-line, rotatoria, 36 sin sin bloqueo.	K. STORZ	
2	Porta-agujas laparoscópica KOH, curvo izquierda, 5 mm.	K. STORZ	
2	Pinza de agarre fenestrada, click-line, rotatoria, 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre y disección curva, click-line, rotatoria, 43 cm.	K. STORZ	
2	Cable de luz fría diámetro 4.8 mm., longitud 250 cm.	K. STORZ	
2	Óptica laparoscopia diámetro 10 mm., visión 30°	K. STORZ	

INSTRUMENTAL DE MICRO-CIRUGÍA LARÍNGEA (QX8 ORL)

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Pinzas de agare KLEINSASSER, curva derecha, long. 23 cm.	K. STORZ	
1	Tijera micro-laringe KLEINSASSER, curva derecha, long. 23 cm.	K. STORZ	
1	Pinza LINDHOLM para separación cuerdas vocales, long. 24 cm.	K. STORZ	
1	Deslizanudos de micr-laringe KLEINSASSER, long. 23 cm.	K. STORZ	

CAJA DE INSTRUMENTOS CIRUGIA LAPAROSCÓPICA (GINECOLOGÍA) - TIPO B

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
-----	-------------	-------	---------

1	Recipiente de plástico para esterilización instrumental, 530x250x145 mm.	K. STORZ	
1	Óptica laparoscopia diámetro 10 mm., visión 0º	K. STORZ	
1	Óptica laparoscopia diámetro 10 mm., visión 30º	K. STORZ	
1	Cable de luz fría diámetro 4.8 mm., longitud 250 cm.	K. STORZ	
2	Porta-agujas laparoscópica KOH, mango recto, 5 mm.	K. STORZ	
1	Tijera recta coagulación bipolar ROBI, CLERMONT-FERRAND	K. STORZ	
1	Cable de coagulación bipolar, longitud 300 cm.	K. STORZ	
1	Cable de coagulación monopolar, longitud 300 cm.	K. STORZ	
1	Electrodo de disección y coagulación monopolar, long. 5 mm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre dentada 2 x 4, MANHES, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre dentado múltiple, MANHES, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre intestinal fenestrada, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre fenestrada, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre dentada, MANGESHKAR, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre nódulos linfáticos, SCHNEIDER, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinzas vasculares endoscópicas, SATINSKY, 10 mm., long. 30 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre dentada atraumática, DeBAKEY, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Anudador extracorpóreo según CLERMON-FERRAND	K. STORZ	
1	Instrumento de sutura extracorpórea, 2.8 mm.	K. STORZ	
1	Cánula de punción hepática, diámetro 3.6 mm., aguja 1.6 mm.	K. STORZ	

CAJA DE INSTRUMENTOS CIRUGIA LAPAROSCÓPICA (GINECOLOGÍA) - TIPO A

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Recipiente de plástico para esterilización instrumental, 530x250x145 mm.	K. STORZ	
1	Óptica laparoscopia diámetro 5.0 mm., visión 0º	K. STORZ	
1	Cable de luz fría diámetro 4.8 mm., longitud 300 cm.	K. STORZ	
1	Porta-agujas laparoscópica KOH, mango recto, 5 mm.	K. STORZ	
1	Cable de coagulación bipolar, longitud 300 cm.	K. STORZ	
1	Cable de coagulación monopolar, longitud 300 cm.	K. STORZ	
1	Electrodo de disección y coagulación monopolar, long. 5 mm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre dentada 2 x 4, MANHES, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre dentado múltiple, MANHES, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre intestinal fenestrada, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre fenestrada, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Anudador extracorpóreo según CLERMON-FERRAND	K. STORZ	

CAJA DE INSTRUMENTOS CIRUGIA LAPAROSCÓPICA (GINECOLOGÍA) - TIPO A

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Recipiente de plástico para esterilización instrumental, 530x250x145 mm.	K. STORZ	
1	Óptica laparoscopia diámetro 5.0 mm., visión 0º	K. STORZ	
1	Cable de luz fría diámetro 4.8 mm., longitud 300 cm.	K. STORZ	
1	Porta-agujas laparoscópica KOH, mango recto, 5 mm.	K. STORZ	
1	Cable de coagulación bipolar, longitud 300 cm.	K. STORZ	
1	Cable de coagulación monopolar, longitud 300 cm.	K. STORZ	
1	Electrodo de disección y coagulación monopolar, long. 5 mm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre y disección curva, KELLY, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre dentado múltiple, MANHES, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre intestinal fenestrada, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre fenestrada, click-line, long. 36 cm.	K. STORZ	
1	Anudador extracorpóreo según CLERMONT-FERRAND	K. STORZ	

INSTRUMENTAL QX8 ORL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	Pinzas auriculares extrafinas, FISCH, longitud 8 cm.	K. STORZ	

1	Tijeras nasales rectas CENS, RHINOFORCE II, longitud 13 cm.	K. STORZ	
---	---	----------	--

MONITOR Y SOPORTE MONITOR LAPAROSCOPIA TORÁCICA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Monitor plano quirúrgico HD, pantalla 27"	LG	
1	SopORTE con ruedas LD, para Monitor de 27"	K. STORZ	

EQUIPO DE RESECCIÓN MONOPOLAR - QX1 UROLOGÍA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	Óptica de resector HOPKINS II, diámetro 4.0 mm., visión 30º	K. STORZ	
1	Juego de Vainas de irrigación continua de 26 Ch., p/resector	K. STORZ	
1	Obturador roma deflectante para vaina de 26 Ch.	K. STORZ	

CISTOSCOPIO COMPACTO - UROLOGÍA INFANTIL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	CISTOSCOPIO COMPACTO 17 CH., VISIÓN 30º	K. STORZ	
1	Pinza de agarre dentada, semi-rígida, diámetro 7 Ch.	K. STORZ	
1	Aguja de punción flexible, diámetro 6 Ch., longitud 50 cm.	K. STORZ	

3 x EQUIPOS DE HISTEROSCOPIA (CONSULTAS HISTEROSCOPIA) - GINECOLOGÍA

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
2	Óptica histeroscópica HOPKINS II, diámetro 2.0 mm., visión 30º	K. STORZ	
2	Vaina externa de histeroscopia, irrigación continua, tamaño 5.0 mm.	K. STORZ	
2	Vaina interna de histeroscopia, con canal de trabajo, tamaño 4.3 mm.	K. STORZ	
2	Pinza de agarre dentada, semi-rígida, diámetro 5 Ch., long. 34 cm.	K. STORZ	
2	Pinza de biopsia, semi-rígida, diámetro 5 Ch., long. 34 cm.	K. STORZ	
2	Tijera recta punta roma, semi-rígida, diámetro 5 Ch., long. 34 cm.	K. STORZ	
1	Óptica histeroscópica HOPKINS II, diámetro 2.9 mm., visión 30º	K. STORZ	
1	Vaina externa de histeroscopia, irrigación continua, tamaño 4.2 mm.	K. STORZ	
1	Vaina interna de histeroscopia, con canal de trabajo, tamaño 3.6 mm.	K. STORZ	
1	Pinza de agarre dentada, semi-rígida, diámetro 5 Ch., long. 34 cm.	K. STORZ	
1	Pinza de biopsia, semi-rígida, diámetro 5 Ch., long. 34 cm.	K. STORZ	
1	Tijera recta punta roma, semi-rígida, diámetro 5 Ch., long. 34 cm.	K. STORZ	

FUENTE DE LUZ LED 150 W. (FOTOFORO ORL INFANTIL) - QX2 MATERNAL

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	FUENTE DE LUZ LED 150 W, MOD. NOVA	K. STORZ	

FOTOFORO Y FUENTE DE LUZ LED ORL (QX2 - MATERNO INFANTIL)

QTY	DESCRIPCIÓN	MARCA	Nº INV.
1	FOTOFORO DE LUZ FRÍA DE ALTA POTENCIA, MOD. KS60	K. STORZ	
1	FUENTE DE LUZ LED 150 W, MOD. NOVA	K. STORZ	

ANEXO II: MODELO PROPUESTA DE PRECIOS DE REPOSICIÓN

• **ENDOSCOPIOS RÍGIDOS**

Referencia	Especialidad	Dir. Visión	Longitud	Diámetro	Precio de reposición
7230 AA	ORL - NEURO	0º	18 cm	4.0 mm	
7230 BA	ORL - NEURO	30º	18 cm	4.0 mm	(*)
7230 AWA	ORL - NEURO	0º	18 cm	4.0 mm	(*)
7230 BWA	ORL - NEURO	30º	18 cm	4.0 mm	(*)
7230 FWA	ORL - NEURO	45º	18 cm.	4.0 mm.	
28731 BWA	TRAUMATOLOGÍA	30º	18 cm	4.0 mm	
27005 AA	UROLOGÍA	0º	30 cm	4.0 mm	
27005 BA	UROLOGÍA -GINECOLOGÍA	30º	30 cm	4.0 mm	(*)
27005 CA	UROLOGÍA	70º	30 cm	4.0 mm	
27002 L	UROLOGÍA	0º	43 cm.	9.5 Ch.	
27035 BA	UROLOGÍA	30º	22 cm.	17,0 Ch.	
26003 AA	CIRUGÍA -GINECOLOGÍA-UROLOGÍA	0º	31 cm	10.0 mm	(*)
26003 BA	CIRUGÍA -GINECOLOGÍA-UROLOGÍA	30º	31cm	10.0 mm	(*)
26046 AA	CIRUGÍA – GINECOLOGÍA (ICG)	0º	29cm	5.0 mm	
26046 BA	CIRUGÍA – GINECOLOGÍA (ICG)	30º	29cm	5.0 mm	
26003 ACA	CIRUGÍA -GINECOLOGÍA-UROLOGÍA	0º	31 cm	10.0 mm	
26003 BCA	CIRUGÍA -GINECOLOGÍA-UROLOGÍA	30º	31cm	10.0 mm	
26120 BA	GINECOLOGÍA- HISTEROSCOPIA	30º	30cm	2.9 mm	(*)
26008 BA	GINECOLOGÍA- HISTEROSCOPIA	30º	26cm	2.0 mm	(*)
27293 AA	UROLOGIA - NEFROSCOPIA	6º	25cm	6.0 mm	
27033 AA	UROLOGIA INFANTIL	0º	20cm	1.2 mm	
27017 AA	UROLOGIA INFANTIL	0º	18cm	2.1 mm	(*)
27017 BA	UROLOGIA INFANTIL	30º	18cm	2.1 mm	(*)
7229 AA	ORL INFANTIL	0º	18cm	2.7 mm	(*)
8712 AA	ORL INFANTIL	0º	24cm	5.0 mm	
8712 BA	ORL INFANTIL	30º	24cm	5.0 mm	
28008 AA	NEUROCIROLOGÍA INFANTIL	0º	26cm	2.0 mm	
28164 AA	NEUROCIROLOGÍA	0º	30cm	4.0 mm	
10324 AA	ORL - BRONCOSCOPIA INFANTIL	0º	36cm	2.9 mm	
1232 AA	ORL	0º	10cm	1.9 mm	
1232 BA	ORL	30º	10cm	1.9 mm	

• **FIBROSCOPIOS**

Referencia	Especialidad	Dir. Visión	Longitud	Diámetro	Canal de Trabajo	Precio de reposición
11272 C1	UROLOGÍA	0º	37 cm	5.0 mm	2.1 mm	(*)
11101 RP2	ORL	0º	30 cm	3.5 mm	SIN CANAL	
11278 A1	UROLOGÍA	0º	67 cm	3.2 mm	1.2 mm	
11001 BN1	ANESTESIA	0º	54 cm	5.2 mm	2.6 mm	

• **VIDEOFIBROSCOPIOS**

Referencia	Especialidad	Dir. Visión	Longitud	Diámetro	Canal de Trabajo	Precio de reposición
11278 V	UROLOGÍA	0º	70 cm	2.7 mm	1.2 mm	(*)
11292 VP	CIRUGÍA	0º	37 cm	5.3 mm	2.1 mm	
11102 CM	ORL	0º	30 cm	2.9 mm.	SIN CANAL	
11101 CM	ORL	0º	30 cm	3.7 mm	SIN CANAL	(*)

• **VIDEOLAPAROSCOPIO 3D**

Referencia	Especialidad	Dir. Visión	Longitud	Diámetro	Canal de Trabajo	Precio de reposición
26606 BA	CIRUGIA CARDIACA	30º	30 cm	10.0 mm	SIN CANAL	

(*) Equipos que más se utilizan en el HCUVA

ANEXO IV:

ACUERDO DE CESIÓN / ENTREGA DE EQUIPOS CLASIFICADOS COMO APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (EN ADELANTE AEE) y RESIDUOS DE LOS MISMOS (EN ADELANTE RAEE).

De una parte;

D. _____, con DNI; _____, en calidad de representante autorizado de (el productor o distribuidor de AEE) _____, con CIF; _____,

y de otra parte;

D. **Ángel Baeza Alcaraz**, con DNI; **27474909Y**, en calidad de representante autorizado del usuario de AEE/productor de RAEE, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, con CIF Q8050008E,

Acuerdan;

1º.- Que en el marco del expediente de contratación pública (COD EXP): _____, el productor/distribuidor de AEE suministra, en las instalaciones del _____ el equipo de las características que se indican a continuación;

DENOMINACIÓN (MARCA MODELO): _____

USO/APLICACIÓN: _____

Nº DE SERIE/Nº FABRICACIÓN: _____

PESO ESTIMADO: _____

Dicho equipo sustituye a otro existente, de las características que se indican a continuación;

DENOMINACIÓN: _____

USO/APLICACIÓN: _____

Nº DE SERIE/Nº FABRICACIÓN: _____

AÑO DE PUESTA EN SERVICIO: _____

PESO ESTIMADO (Kgr): _____

2º.- El equipo que se entrega por parte del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca se cede al productor /distribuidor en condición de residuo (RAEE), caracterizado, conforme al RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como;

- RAEE PROFESIONAL RAEE NO PROFESIONAL
 RAEE HISTÓRICO RAEE NO HISTÓRICO

CATEGORÍA ANEXO I RD 110/2015:

CATEGORÍA ANEXO III RD 110/2015:

GRUPO DE TRATAMIENTO RAEE ANEXO VIII RD 110/2015:

CÓDIGO LER – RAEE:

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca declara la necesidad, por su parte, de desechar el equipo objeto de cesión.

3º.- La cesión del equipo, para su gestión como RAEE, se realiza, en todo caso, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 26 del RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por el que se regulan los requisitos de recogida de RAEE profesionales por los productores de AEE. La recogida del equipo objeto de cesión y la gestión del mismo como RAEE será realiza a través de:

- Un sistema de responsabilidad ampliada del productor, bajo la fórmula de;
 SCRAP (Sistema Colectivo de R.A.). *1

Denominación/Identificación del SCRAP (RAZÓN SOCIAL):
Nº/código de inscripción/autorización del SCRAP:

- SIRA (Sistema Individual de R.A.). *2

Fecha comunicación y nº registro de solicitud ante el órgano autonómico:
.....

- Otros mecanismos (recogida directa de los RAEE por gestor autorizado a cargo del productor). *3

El productor de AEE declara que está inscrito como productor de AEE en el Registro Integrado Industrial (Registro de Productor de Aparatos Eléctricos y Electrónicos del Ministerio de Transición Ecológica, Industria, Comercio y Turismo), con nº de registro:

***1 y *2.** El productor de AEE aporta y adjunta la documentación acreditativa de las correspondientes autorizaciones administrativas / inscripciones oficiales del SCRAP o del SIRA, según corresponda.

***3.** El productor del AEE aporta copia y adjunta la documentación acreditativa de las autorizaciones de transporte y de gestor al que se destinan los RAEE retirados de las instalaciones del HCUVA, así como la copia del contrato de tratamiento suscrito entre el gestor destino y el productor de AEE. Antes de efectuar la retirada, se entregarán al HCUVA las correspondientes copias de la notificación previa de traslado y documento de identificación.

4º.- El productor de AEE asume la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales que son de aplicación a la gestión del los RAEE desde el proceso de desmontaje, el transporte, almacenamiento y la entrega final a la planta de tratamiento. En especial, se compromete a observar y cumplir los requisitos derivados de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados y el Real Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos.

Las partes, a de de 20.....

Por el productor de AAE

Por el H.C.U.V de la Arrixaca

D.....

(Firma y sello)

D.....

(Firma y sello)